


MEDVIE


Date du test: 27/02/2024 11:17:15
Durée: 4mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SIDIBE BANGALY
Date de naissance	16/06/1983
Age	40
Société	RIO TINTO
ID	24022711101428502

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

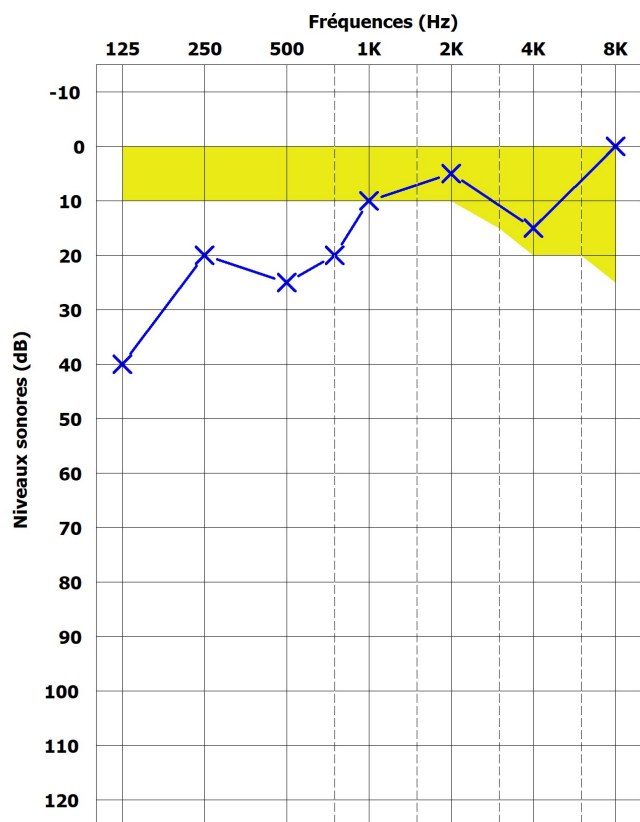

Oreille Gauche

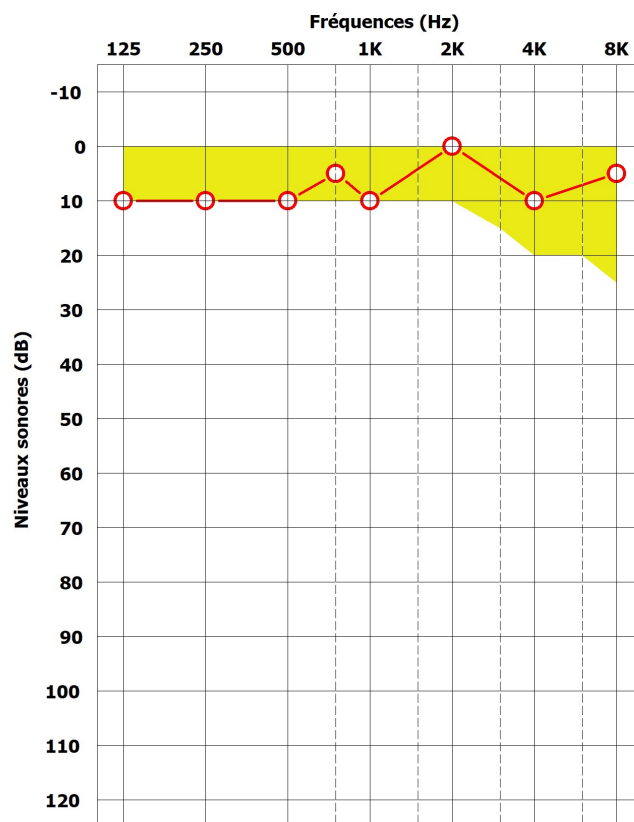

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	20	25	20	10		5		15		0
CA Droit	10	10	10	5	10		0		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes