

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 13:41:12

Durée: 3mn 42s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA FACELY	
Date de naissance	01/01/1975
Age	49
Société	RIO TINTO
ID	24022413381177224

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

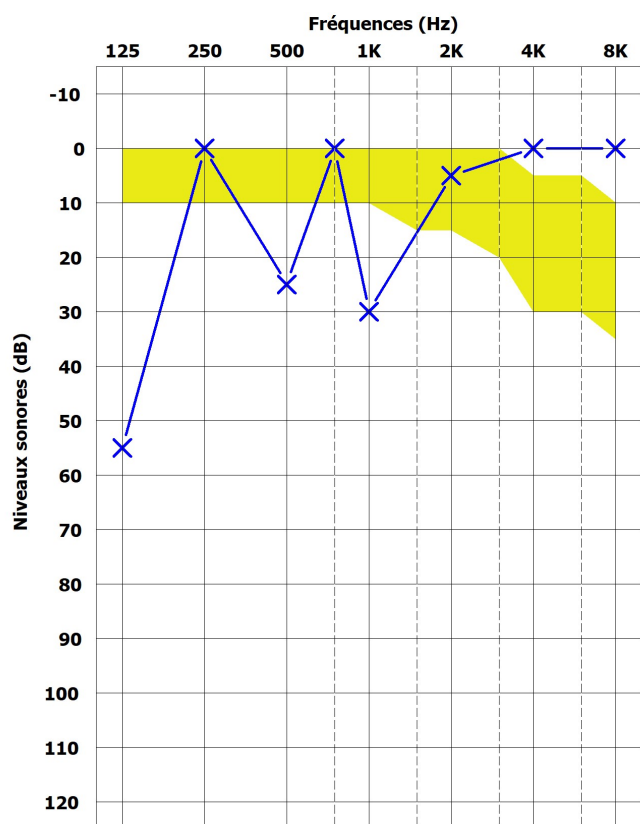

Oreille Gauche

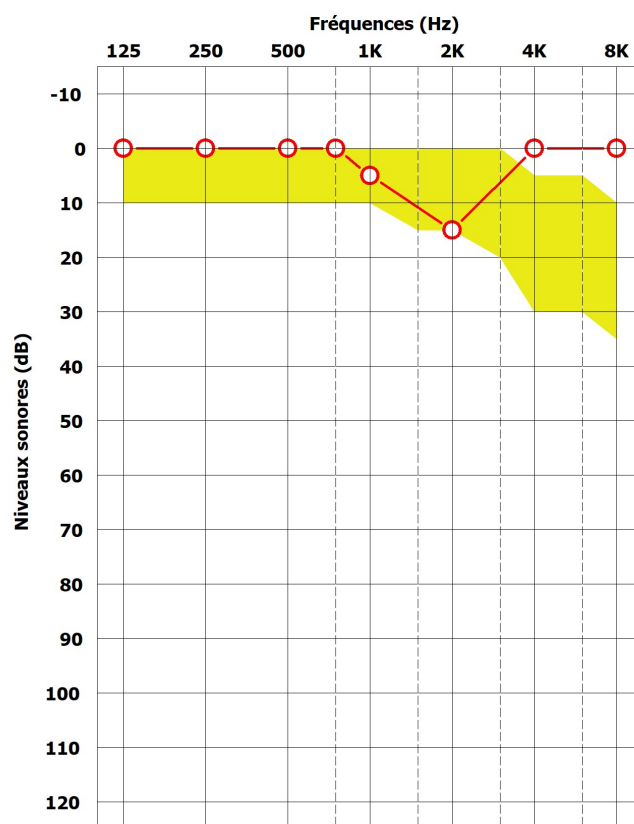

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	55	0	25	0	30		5		0		0
CA Droit	0	0	0	0	5		15		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes