

MEDVIE


Date du test: 02/03/2024 11:15:58

Durée: 7mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SACKO MOHAMED
Date de naissance	15/05/1982
Age	41
Société	RIO TINTO
ID	24030211122660095

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

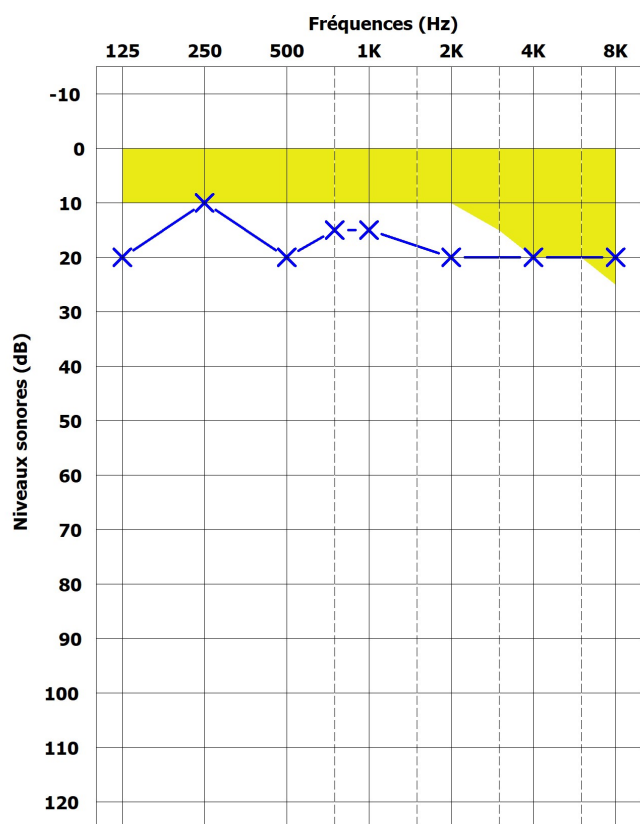

Oreille Gauche

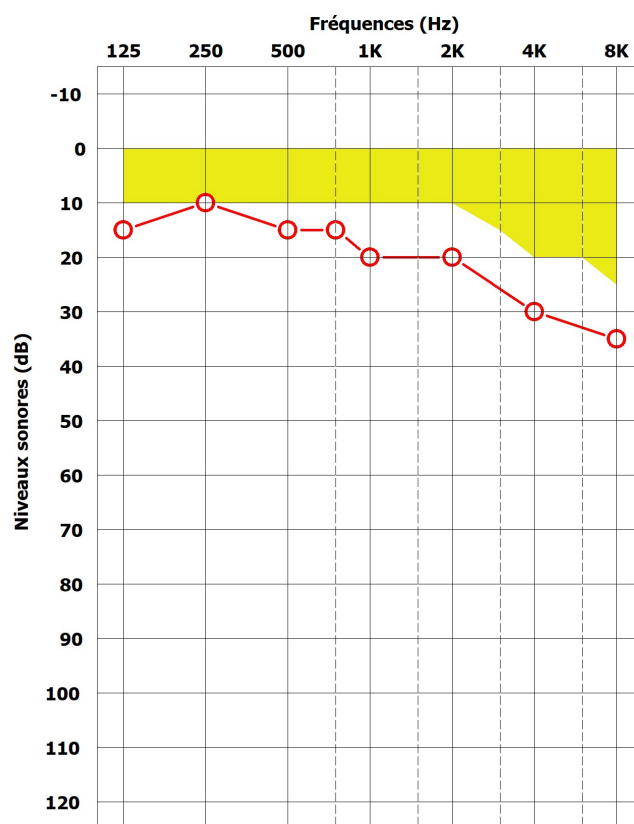

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	20	15	15		20		20		20
CA Droit	15	10	15	15	20		20		30		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes