


MEDVIE

Date du test: 21/03/2025 09:39:41

Durée: 5mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

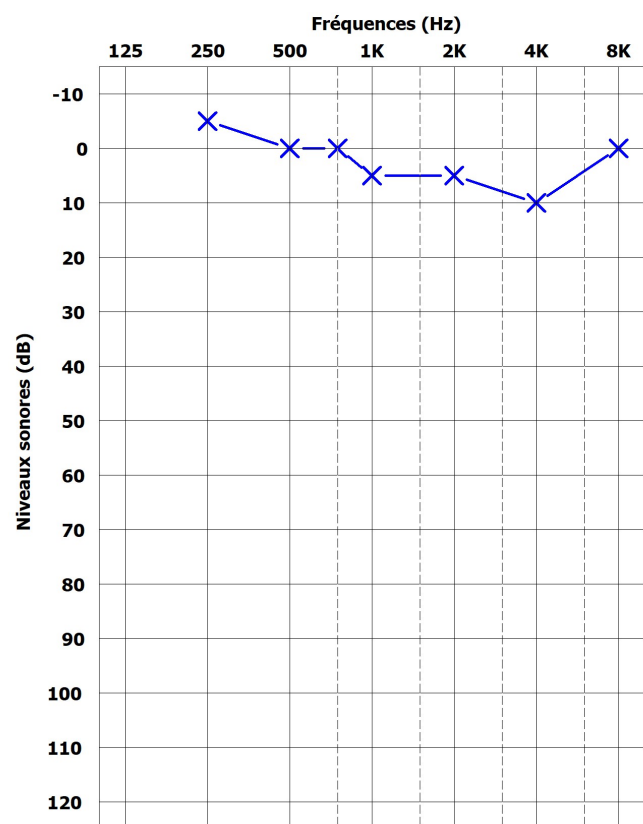

Oreille Gauche

Données Patient	
BYDAWELL SHANNON I OUISE	
Date de naissance	04/07/1983
Age	41
Société	SIMFER
ID	25032109371821974

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

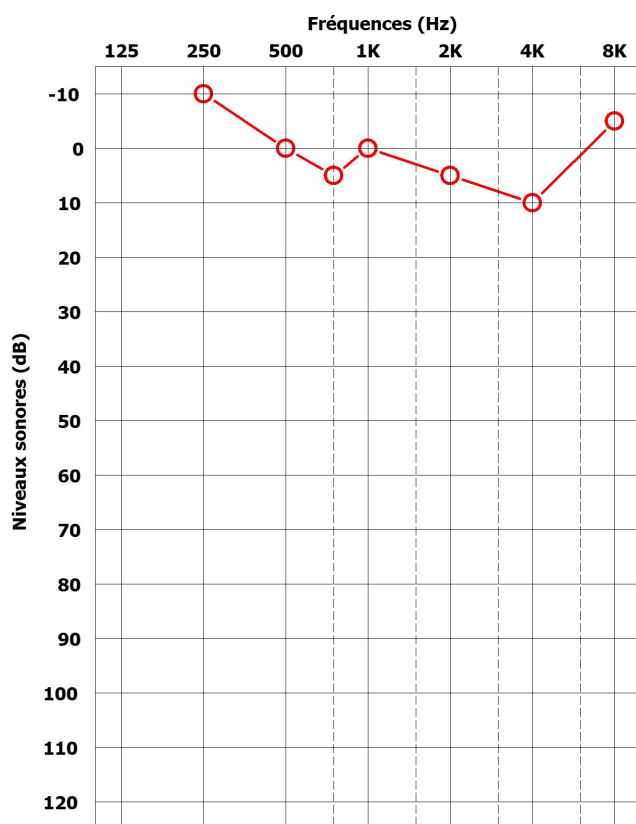

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	0	5		5		10		0
CA Droit		-10	0	5	0		5		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes