

MEDVIE

Date du test: 24/02/2024 10:36:31


Durée: 5mn 55s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard


| Données Patient   | BILIVOGUI GNAKOÏ  |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 23/11/1984        |
| Age               | 39                |
| Société           | RIO TINTO         |
| ID                | 24022410332174813 |

### Audiomètre

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

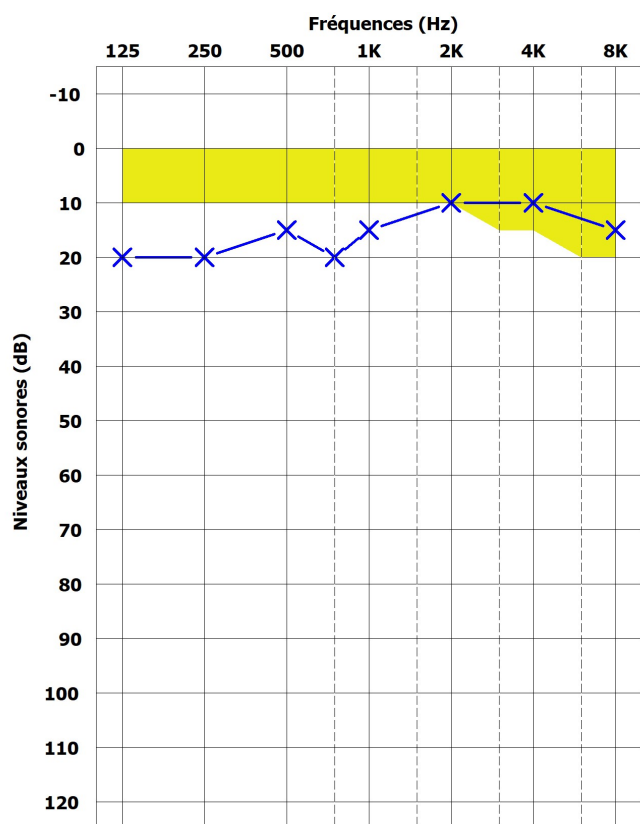

Oreille Gauche

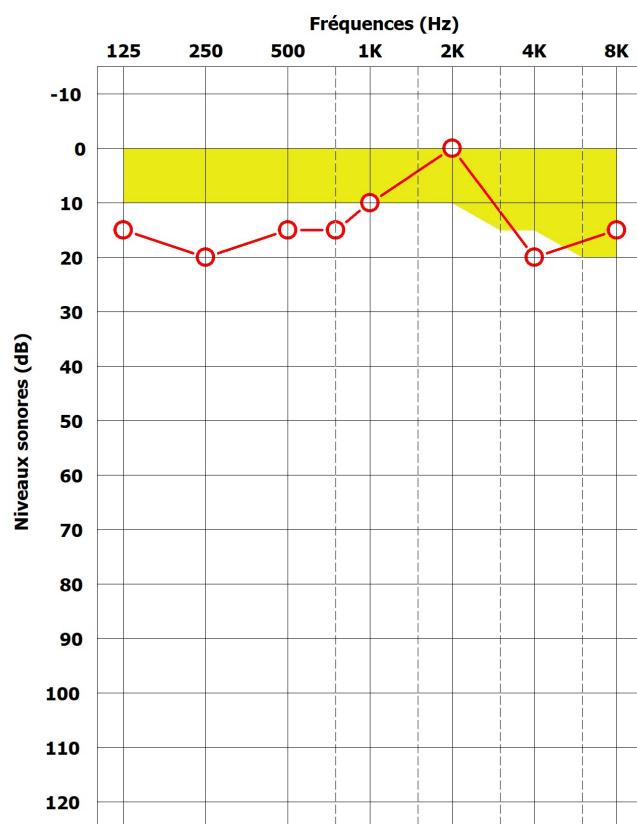

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 20  | 20  | 15  | 20  | 15 |     | 10 |    | 10 |    | 15 |
| CA Droit  | 15  | 20  | 15  | 15  | 10 |     | 0  |    | 20 |    | 15 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 12,5 dB | --- |
| CA Droit  | 11,3 dB | --- |

Notes