


MEDVIE


Date du test: 22/05/2025 11:01:41

Durée: 6mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

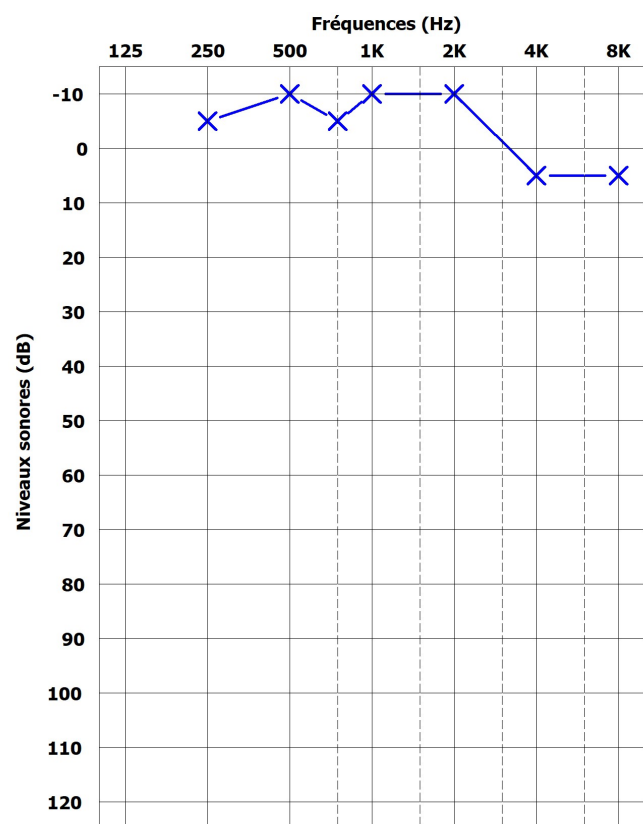

Oreille Gauche

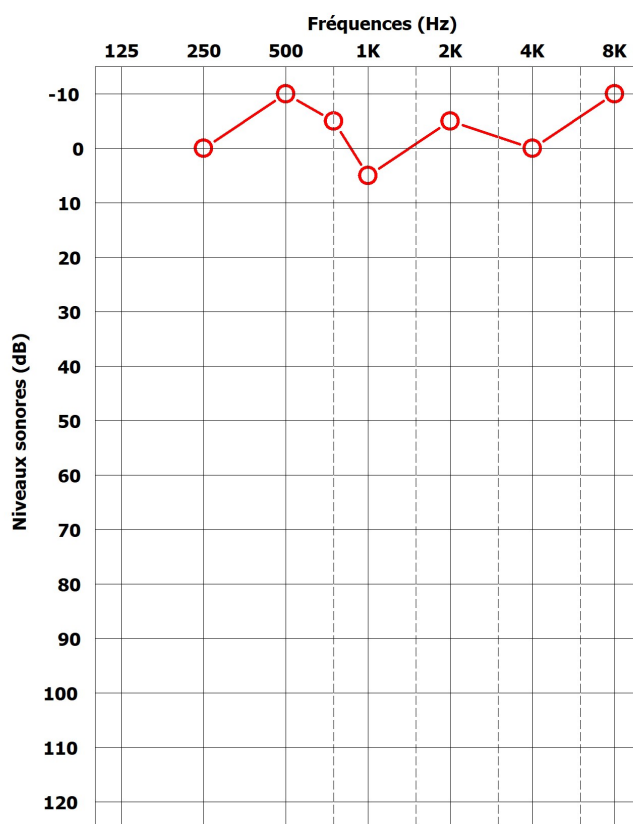

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	-10	-5	-10		-10		5		5
CA Droit		0	-10	-5	5		-5		0		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	-6,3 dB	---
CA Droit	-2,5 dB	---

Notes

Données Patient	GREYLING RIALTO
Date de naissance	07/02/1991
Age	34
Société	SIMFER
ID	25052210582427549

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021