


Données Patient		CHERIF ABOUBACAR
Date de naissance	01/07/1987	
Age	36	
Société	GST	
ID	24062715180296809	


MEDVIE

Date du test: 27/06/2024 15:20:40
 Durée: 3mn 46s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

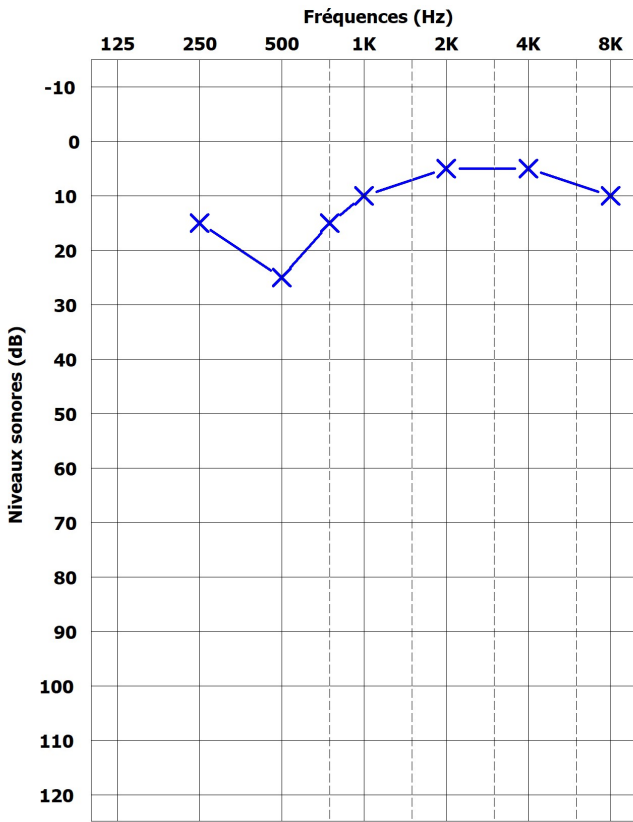

Oreille Gauche

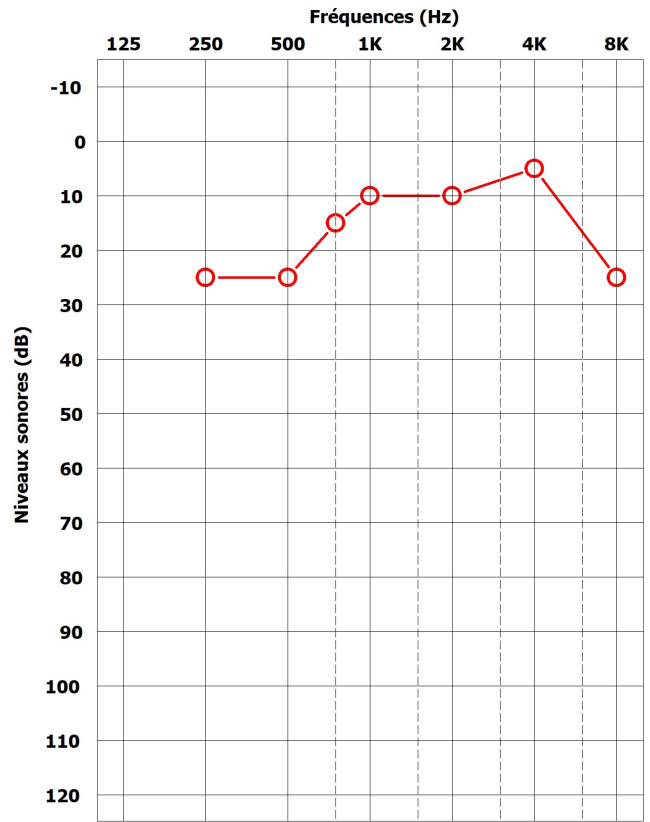

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	15	10		5		5		10
CA Droit		25	25	15	10		10		5		25

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	11,3 dB
CA Droit	12,5 dB	---

Notes