


MEDVIE

Date du test: 11/09/2024 11:40:37

Durée: 5mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

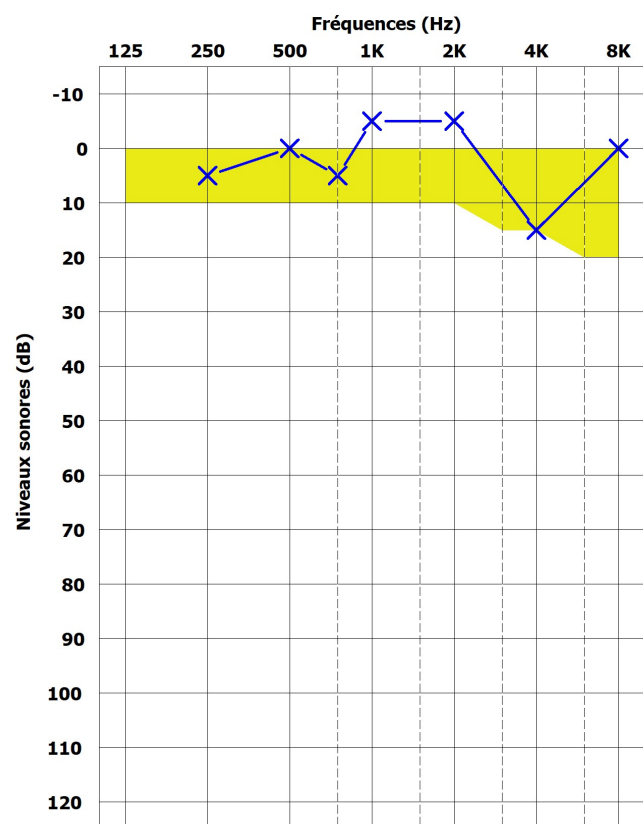

Oreille Gauche

Données Patient	
BUCZYNKI ROMAN	
Date de naissance	03/06/1985
Age	39
Société	
ID	24091111350024673

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

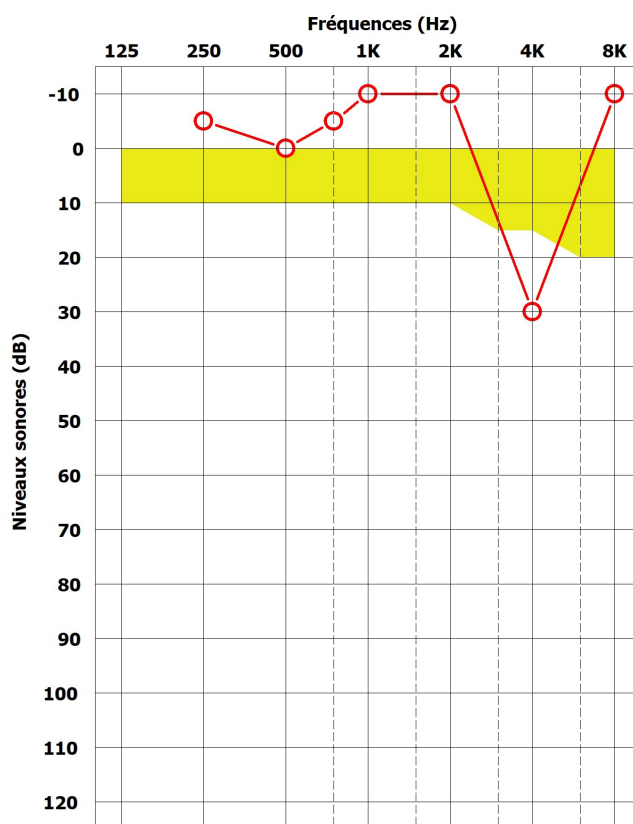

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	5	-5		-5		15		0
CA Droit		-5	0	-5	-10		-10		30		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes