



| Données Patient            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>BAH MOHAMED SALIFOU</b> |                   |
| Date de naissance          | 01/07/1988        |
| Age                        | 36                |
| Société                    | CHEC              |
| ID                         | 24101813354336447 |

Date du test: 11/12/2024 13:17:25  
Durée: 6mn 02s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

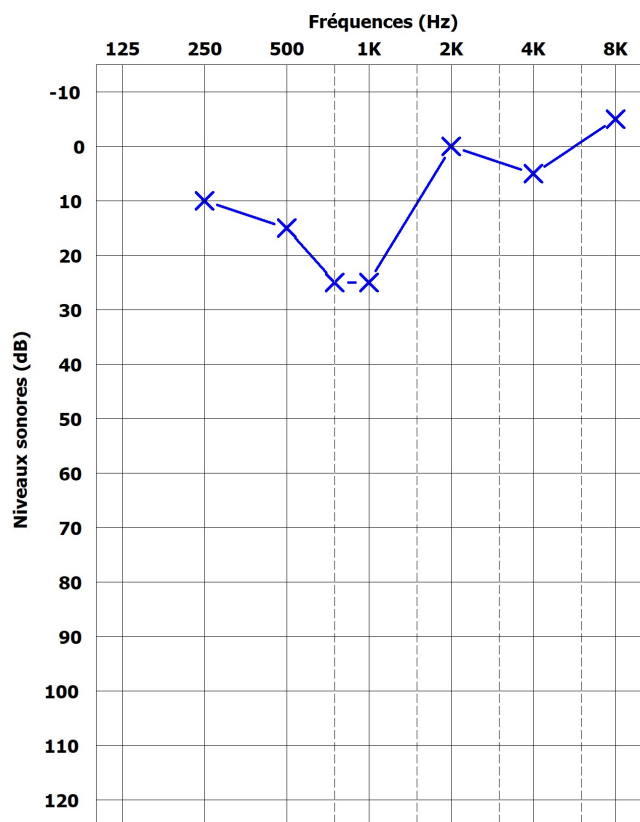

Oreille Gauche

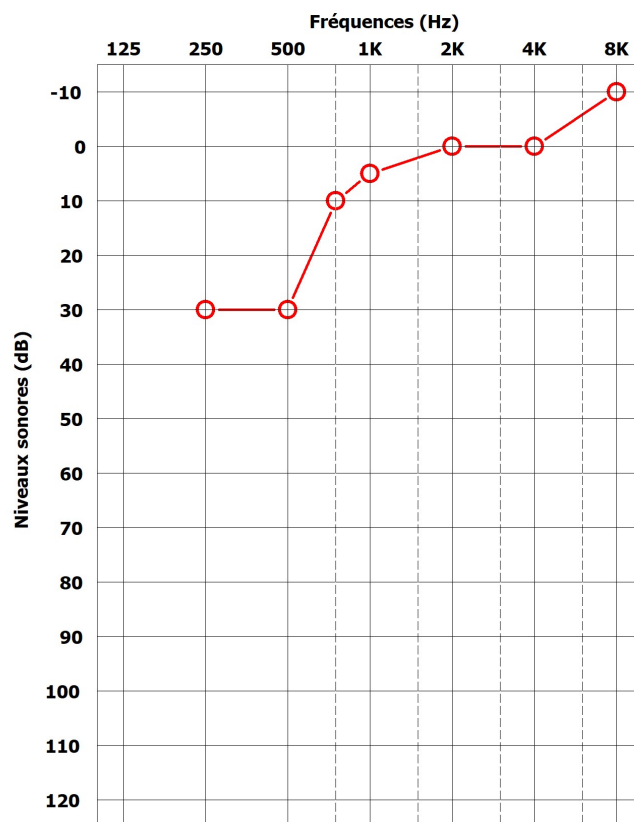

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | 10  | 15  | 25  | 25 |     | 0  |    | 5  |    | -5  |
| CA Droit  |     | 30  | 30  | 10  | 5  |     | 0  |    | 0  |    | -10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 11,3 dB | --- |
| CA Droit        | 8,8 dB  | --- |

Notes