

Données Patient

BANGOURA DONA

Date de naissance 07/06/1982
Age 42
Société CHEC EPC2
ID 24121112442410252


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 11/12/2024 12:46:04

Durée: 4mn 26s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

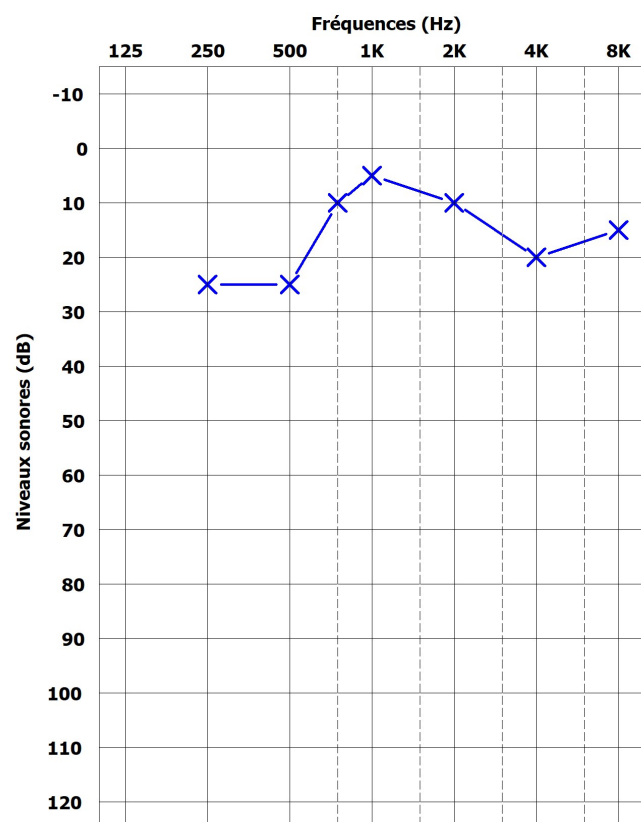

Oreille Gauche

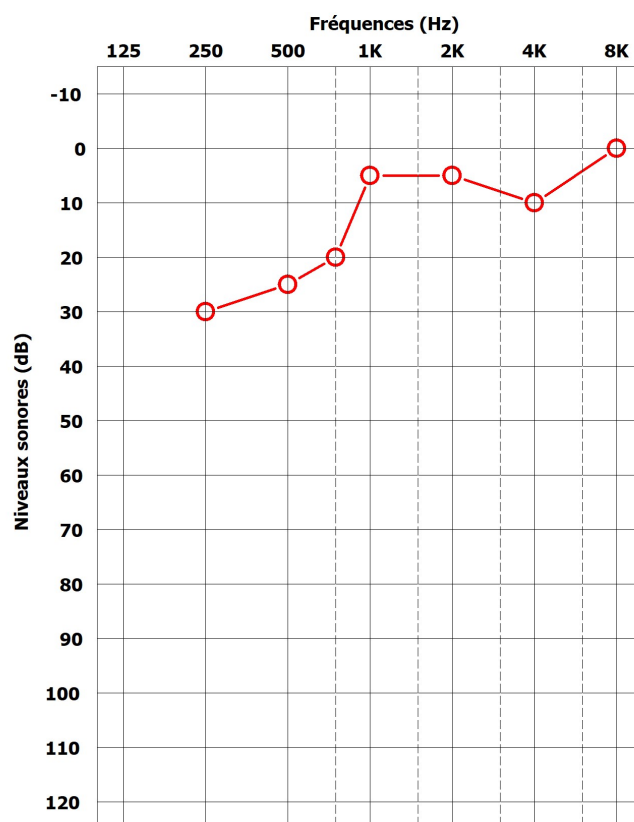

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	10	5		10		20		15
CA Droit		30	25	20	5		5		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes