


MEDVIE


Date du test: 11/07/2025 11:42:31
Durée: 6mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TAHIR HALGUE
Date de naissance		09/09/1991
Age		33
Société		ARTELIA
ID		25071111210432697

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

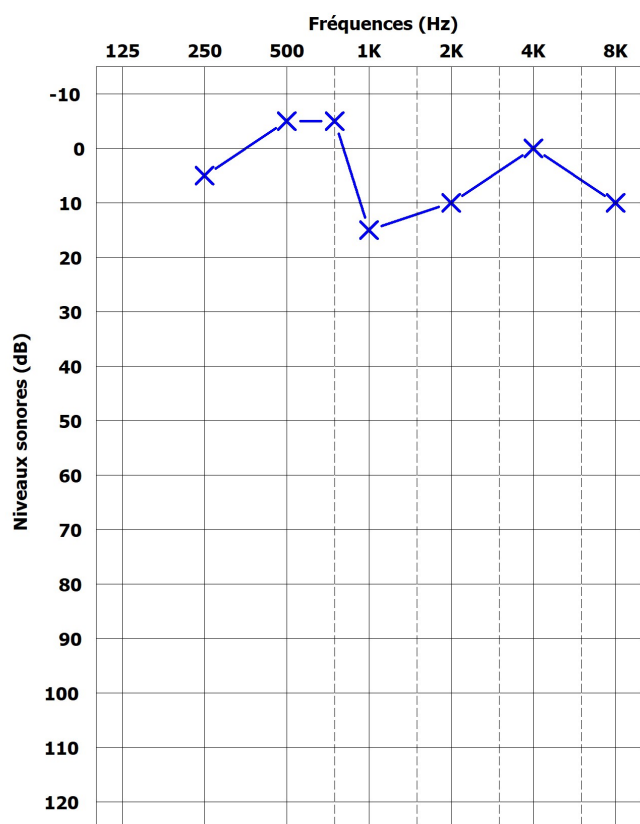

Oreille Gauche

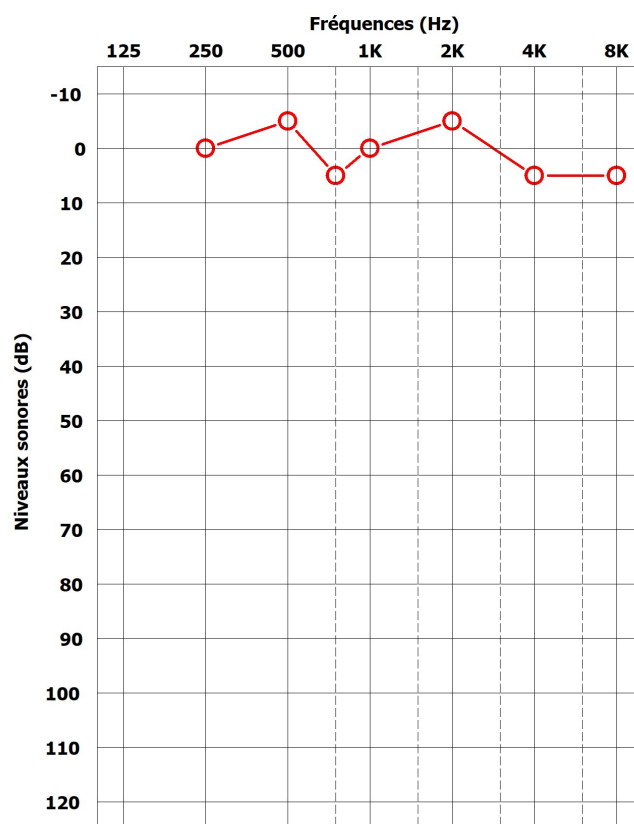

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	-5	-5	15		10		0		10
CA Droit		0	-5	5	0		-5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes