


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 13:50:38
Durée: 3mn 42s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUNAHARA SOUA	
Date de naissance	04/04/1984
Age	40
Société	SMFG
ID	25011013491341529

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

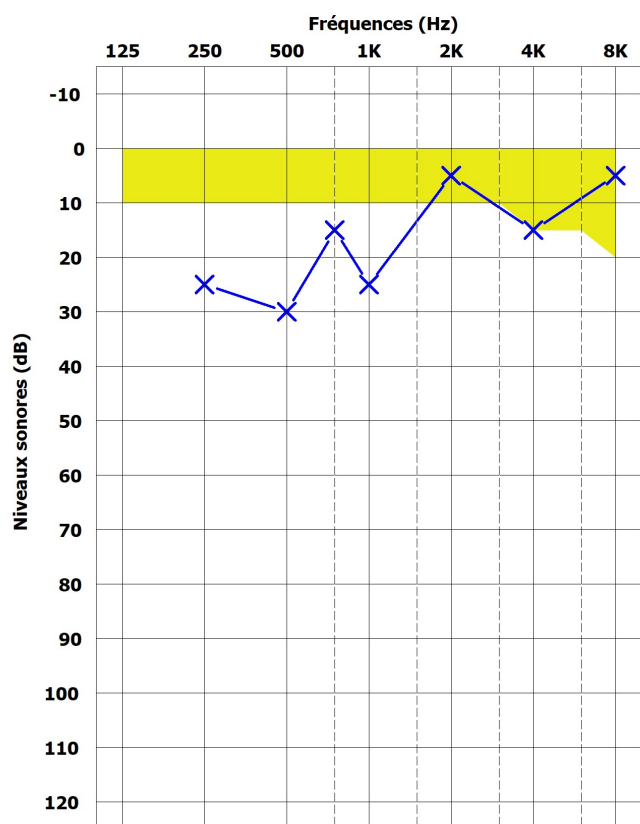

Oreille Gauche

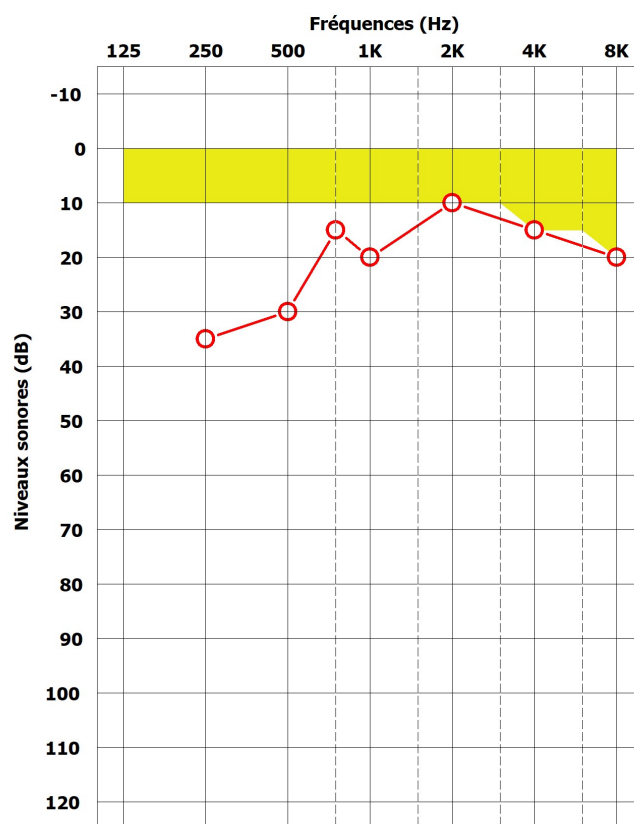

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	15	25		5		15		5
CA Droit		35	30	15	20		10		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes