


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 18:00:49
Durée: 5mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
GBANMOU HOOROU GA70	
Date de naissance	15/06/1965
Age	59
Société	SMFG
ID	25011017535849397

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

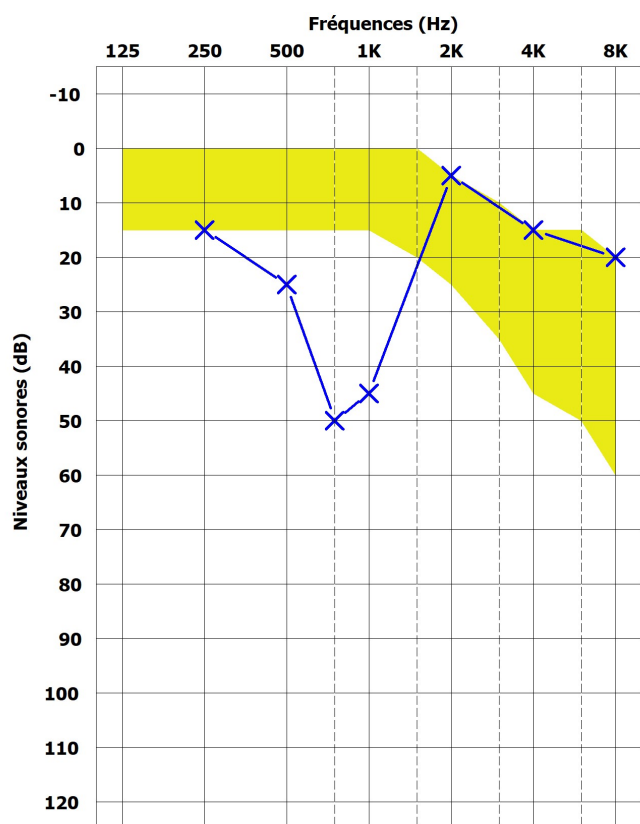

Oreille Gauche

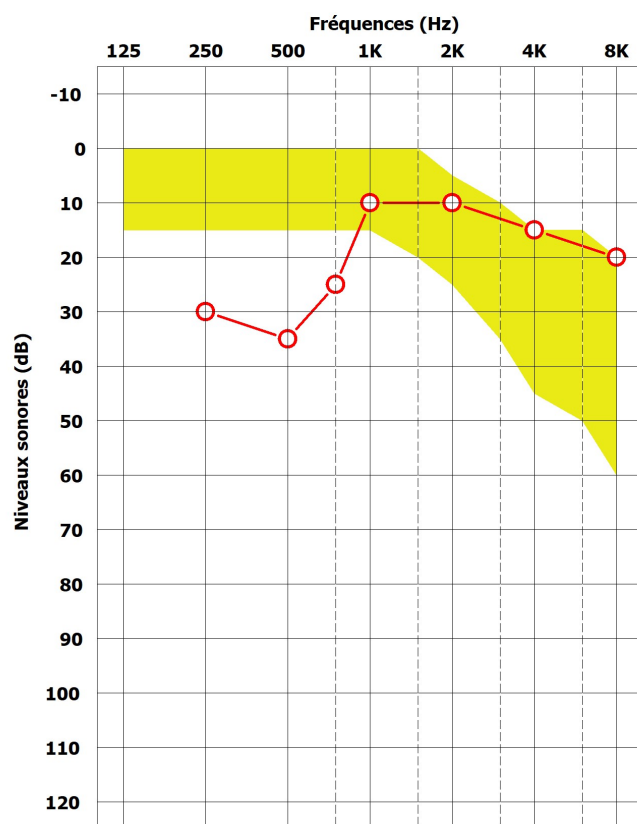

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	50	45		5		15		20
CA Droit		30	35	25	10		10		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes