


MEDVIE


Date du test: 13/01/2025 10:05:39
Durée: 4mn 24s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
GOUMOU NEMA	
Date de naissance	05/02/1980
Age	44
Société	SMFG
ID	25011310033723573

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

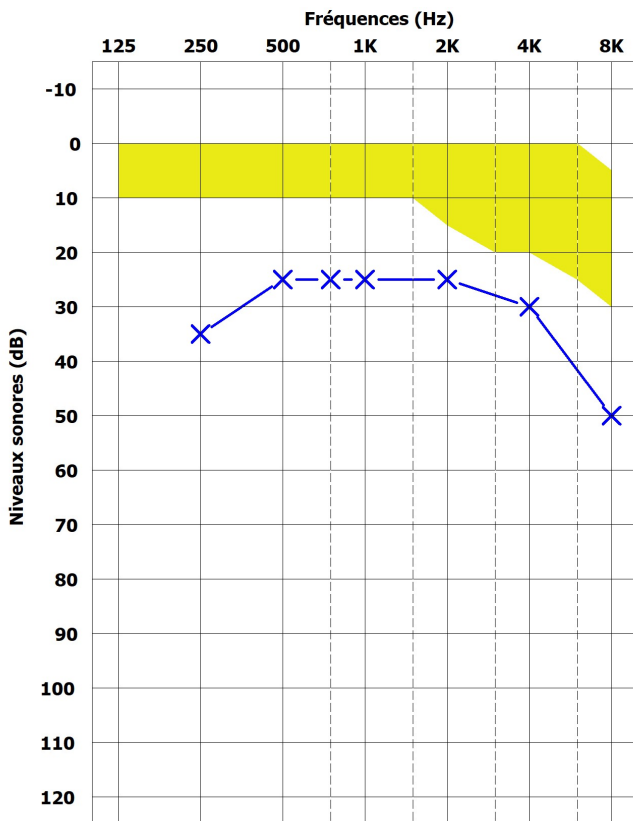

Oreille Gauche

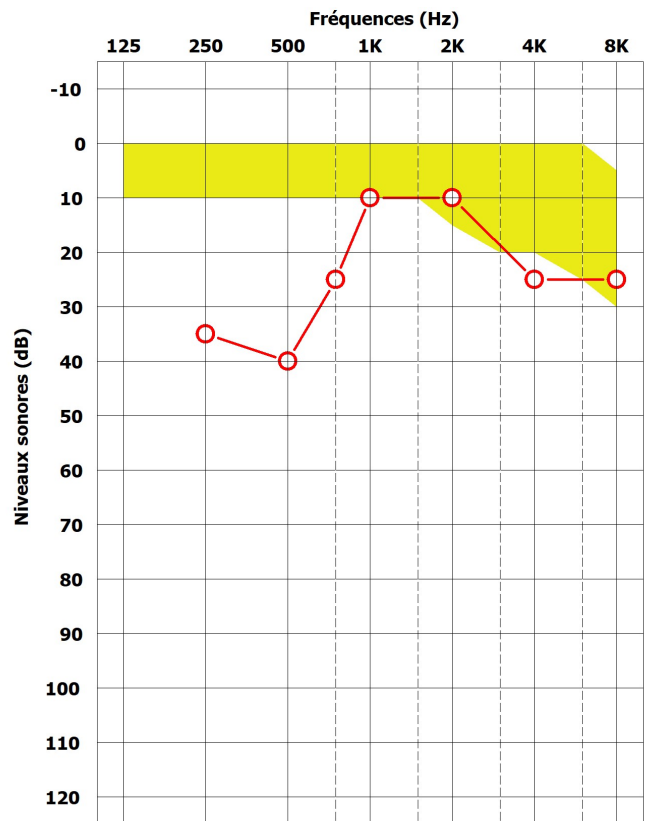

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	25	25		25		30		50
CA Droit		35	40	25	10		10		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes