

MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 11:59:59

Durée: 4mn 42s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | ZOMOU SALEH       |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 02/03/1984        |
| Age               | 40                |
| Société           | SMFG              |
| ID                | 25011111572847936 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

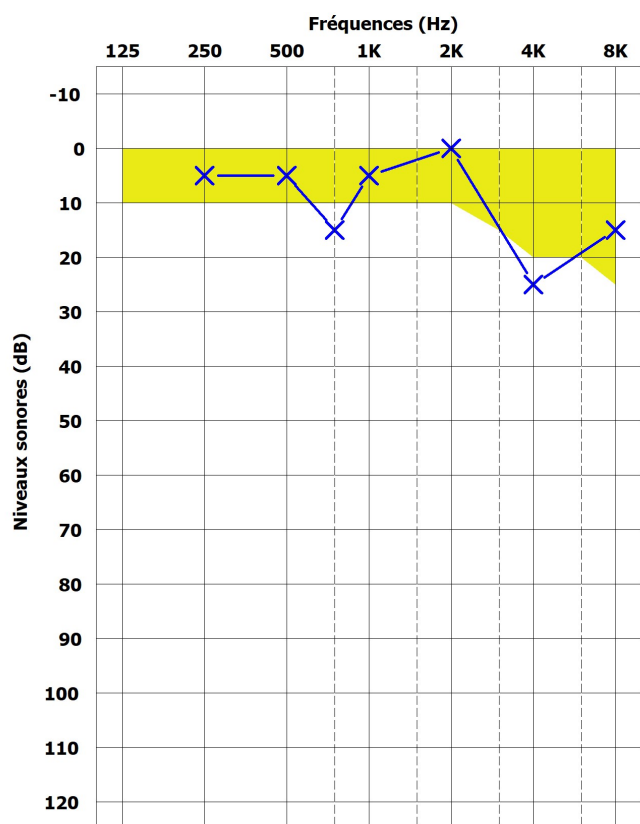

Oreille Gauche

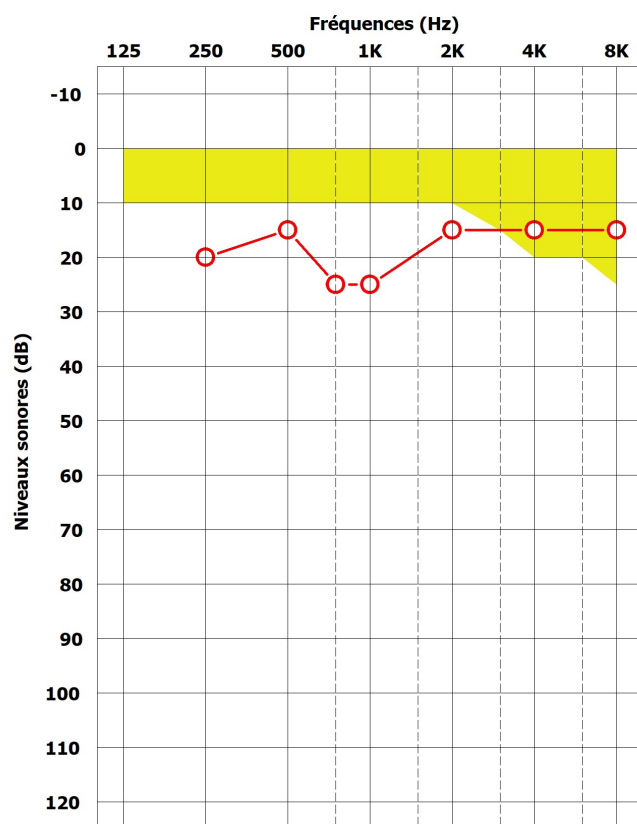

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 5   | 15  | 5  |     | 0  |    | 25 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 20  | 15  | 25  | 25 |     | 15 |    | 15 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 8,8 dB  | --- |
| CA Droit        | 17,5 dB | --- |

Notes