


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 13:36:07
Durée: 4mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAGNO SEKOU	
Date de naissance	01/03/1975
Age	49
Société	EGAS
ID	25011113305510840

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

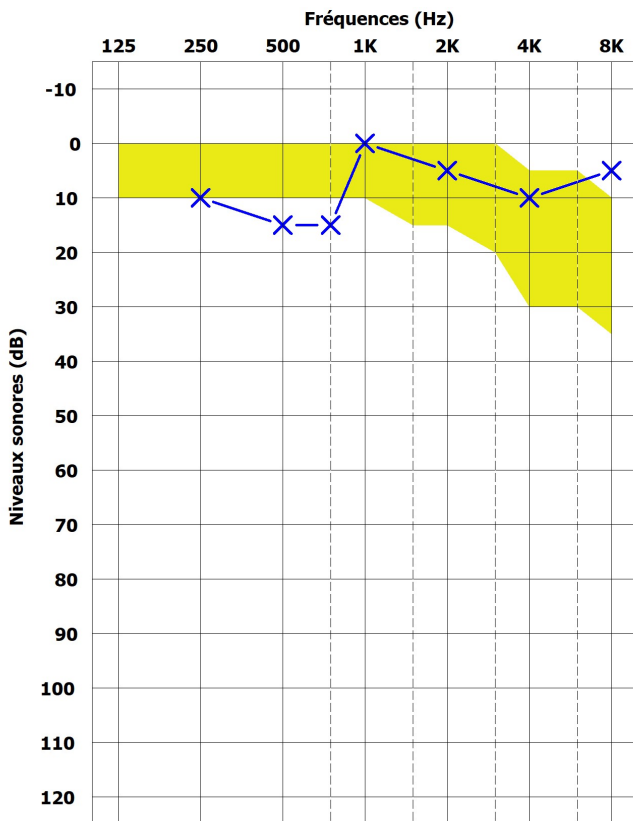

Oreille Gauche

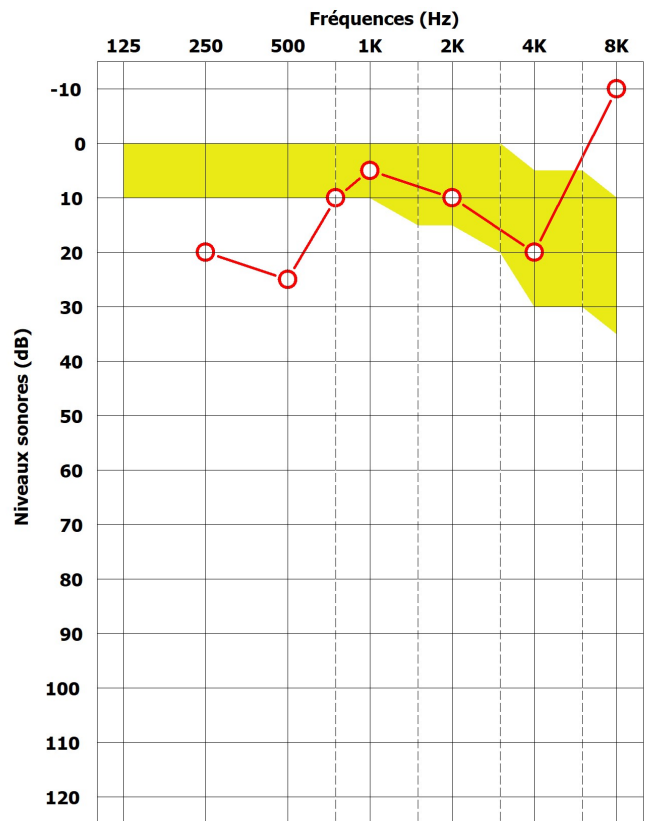

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	0		5		10		5
CA Droit		20	25	10	5		10		20		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes