


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 17:41:57
Durée: 6mn 15s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
Date de naissance	14/06/1978
Age	46
Société	SMFG
ID	25011017354236600

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

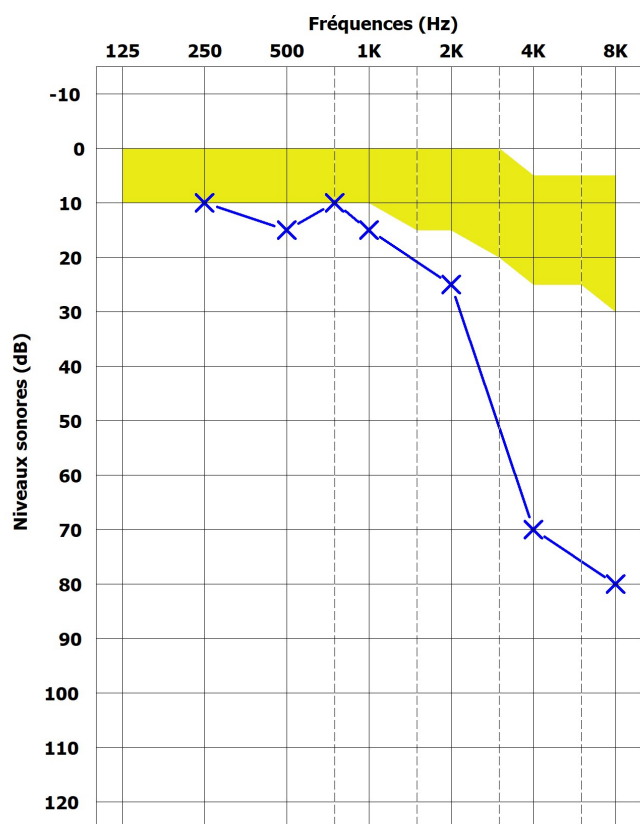

Oreille Gauche

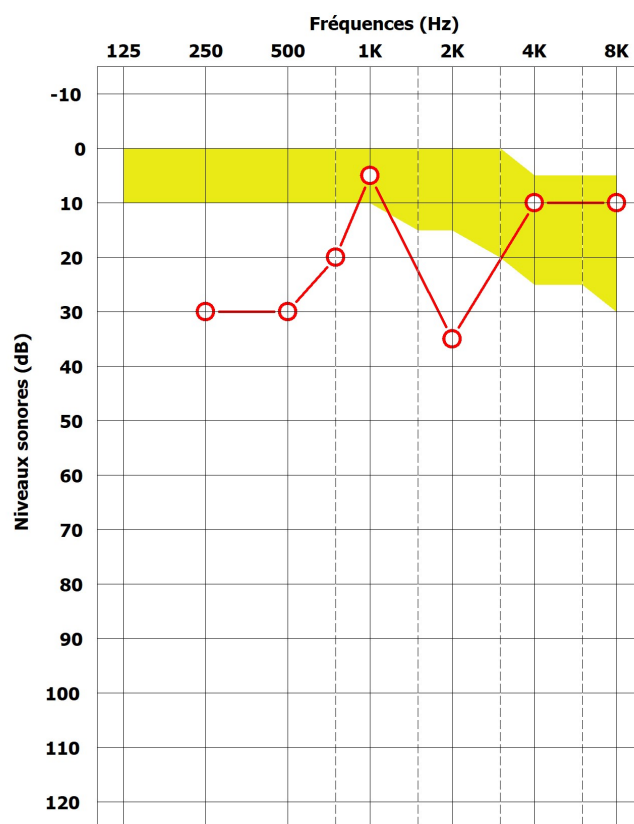

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	15		25		70		80
CA Droit		30	30	20	5		35		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes