
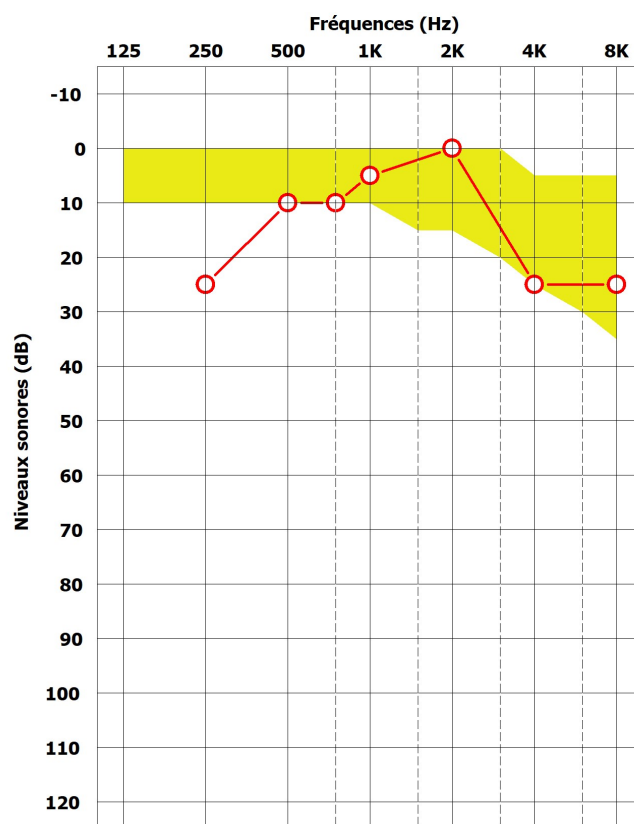


MEDVIE

Date du test: 10/01/2025 14:00:31
Durée: 5mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZOMY CE KONAN	
Date de naissance	01/01/1978
Age	47
Société	SMFG
ID	25011013581757111

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

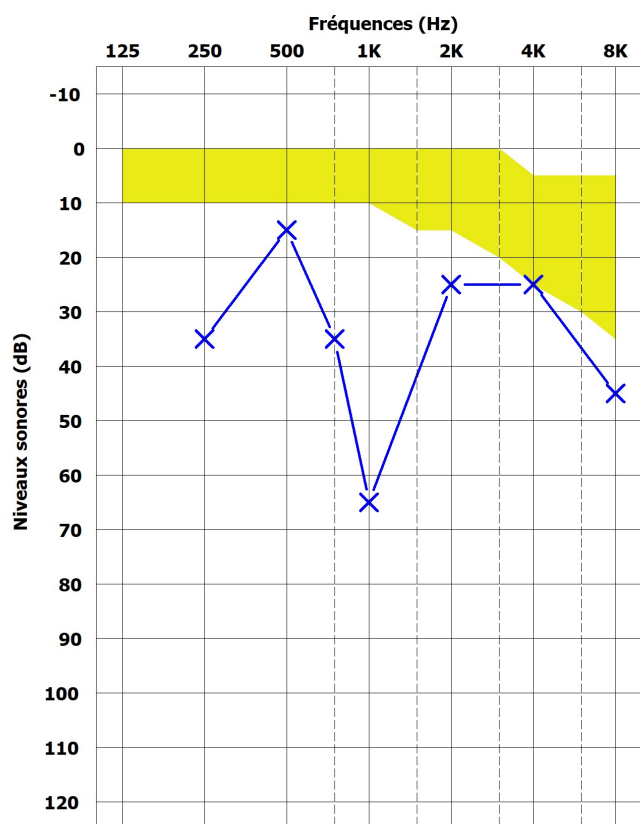

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	15	35	65		25		25		45
CA Droit		25	10	10	5		0		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	32,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes