

MEDVIE

Date du test: 11/01/2025 11:32:14
Durée: 4mn 57s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

LAMAH FIDEL


Date de naissance: 01/01/1982
Age: 43
Société: SMFG
ID: 25011111200340929

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

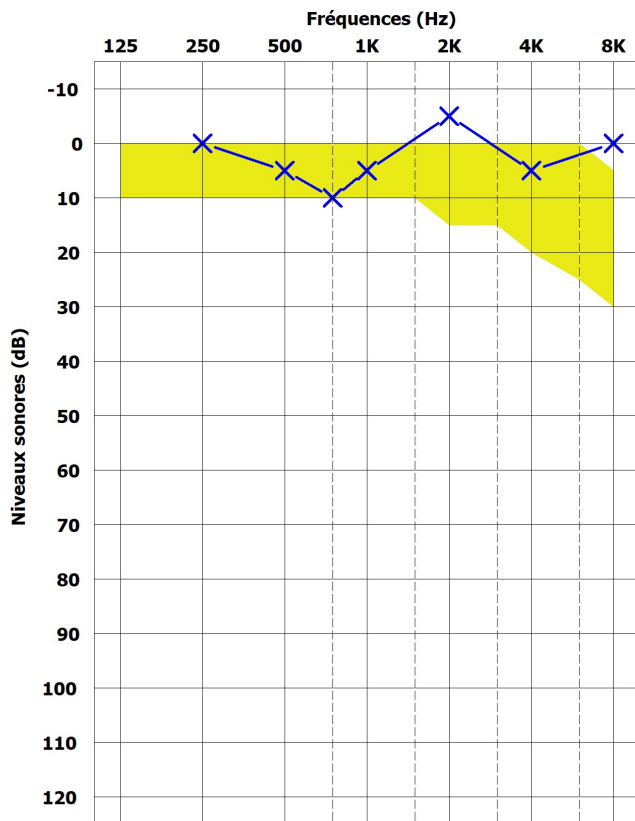

Oreille Gauche

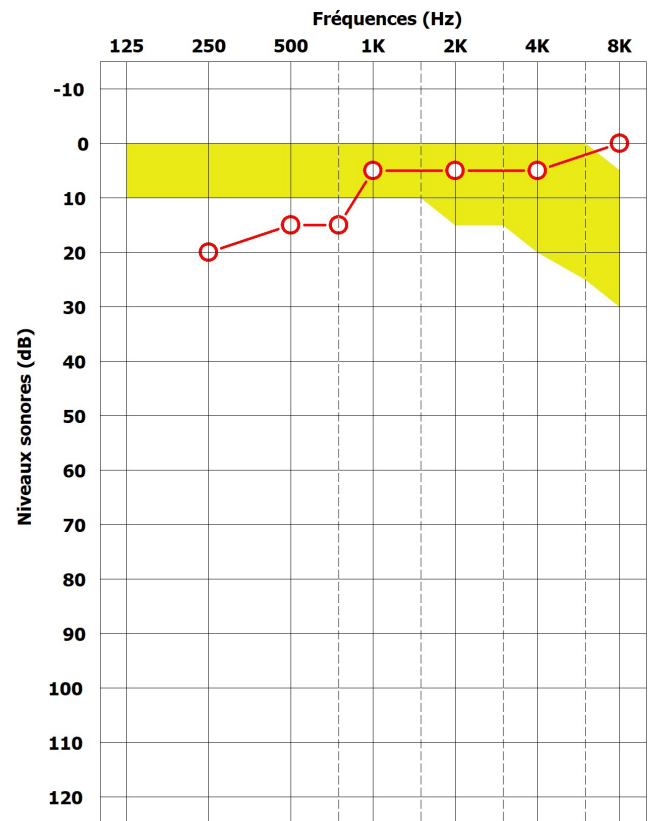

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	10	5		-5		5		0
CA Droit		20	15	15	5		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes