

MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 17:16:14

Durée: 7mn 36s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>GBONIMY JOSEPH</b> |                   |
| Date de naissance     | 27/04/1968        |
| Age                   | 56                |
| Société               | SMFG              |
| ID                    | 25011017053765154 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

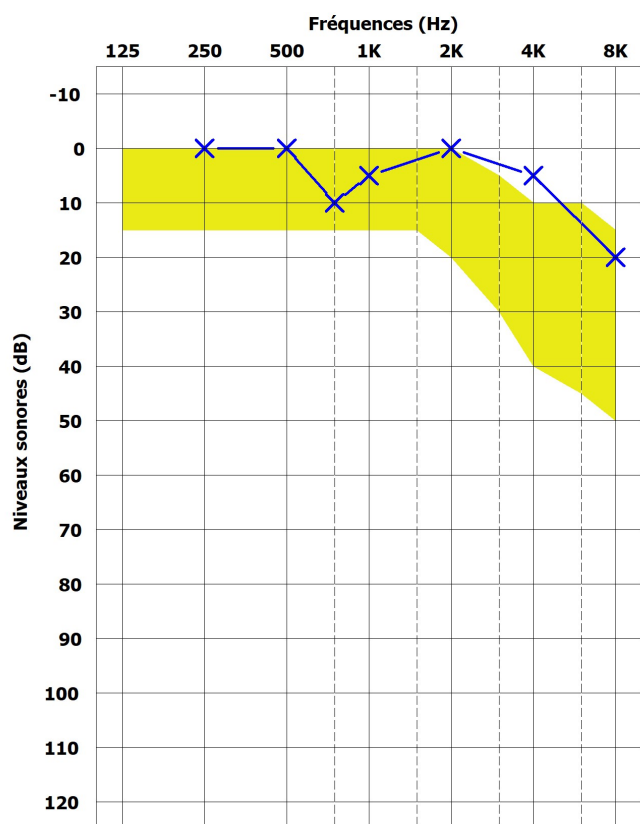

Oreille Gauche

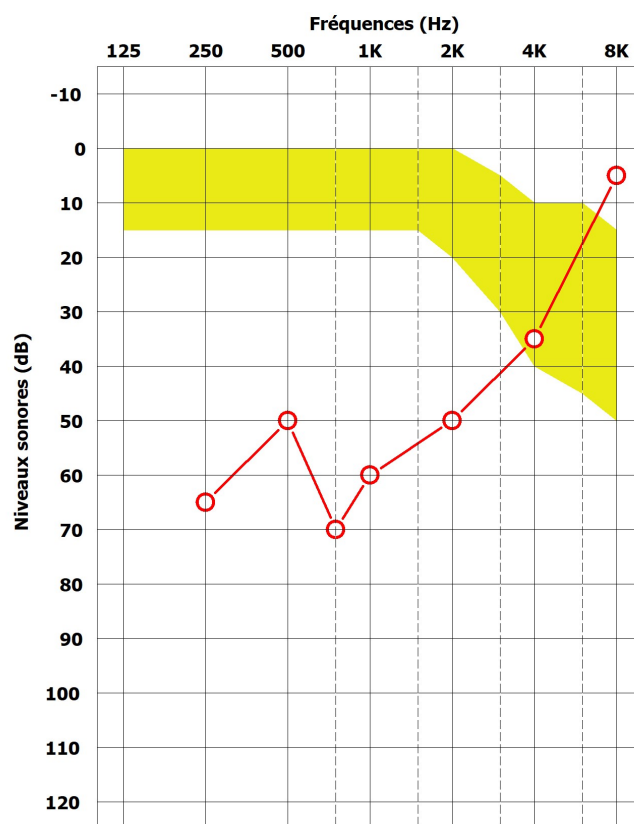

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 0   | 0   | 10  | 5  |     | 0  |    | 5  |    | 20 |
| CA Droit  |     | 65  | 50  | 70  | 60 |     | 50 |    | 35 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 2,5 dB  | --- |
| CA Droit        | 48,8 dB | --- |

Notes