

MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 15:58:58

Durée: 5mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOLIE ZAORO OSCAR	
Date de naissance	20/12/1979
Age	45
Société	SMFG
ID	25011015511898045

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

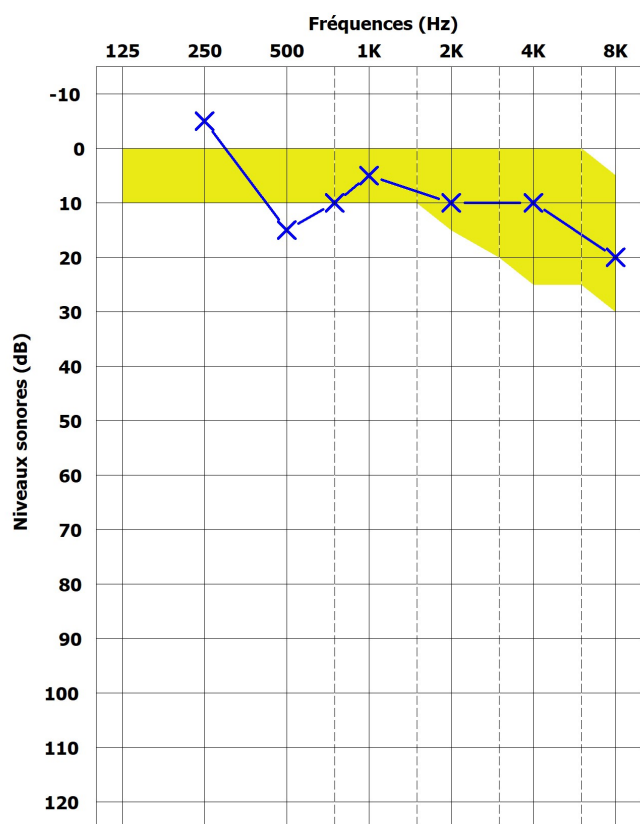

Oreille Gauche

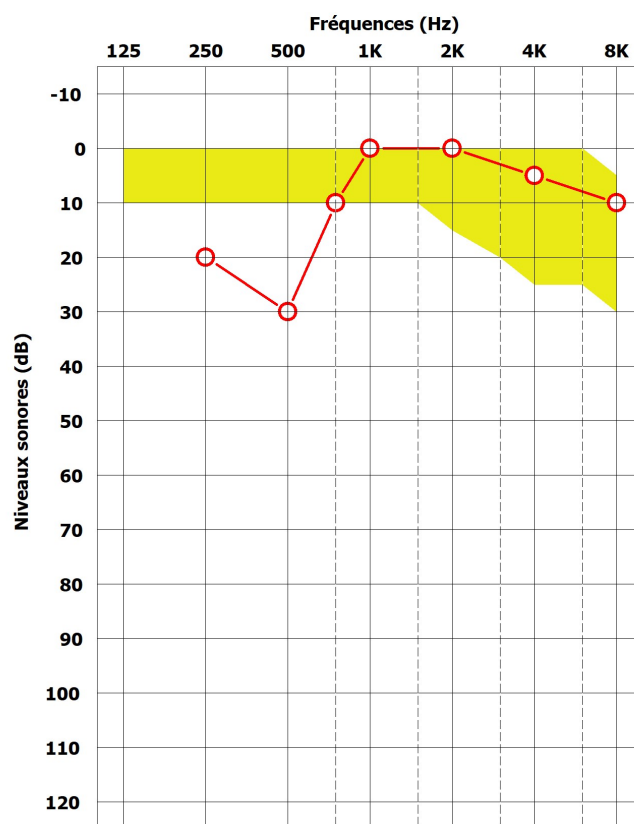

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	15	10	5		10		10		20
CA Droit		20	30	10	0		0		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes