

MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 18:46:56

Durée: 5mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOIBAMY MAMY	
Date de naissance	15/12/1975
Age	49
Société	SMFG
ID	25011018451433896

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

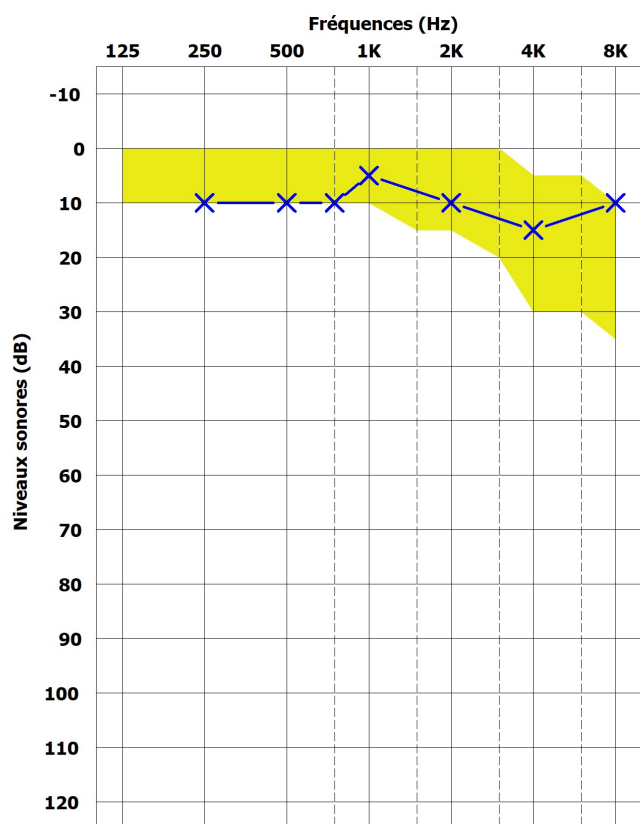

Oreille Gauche

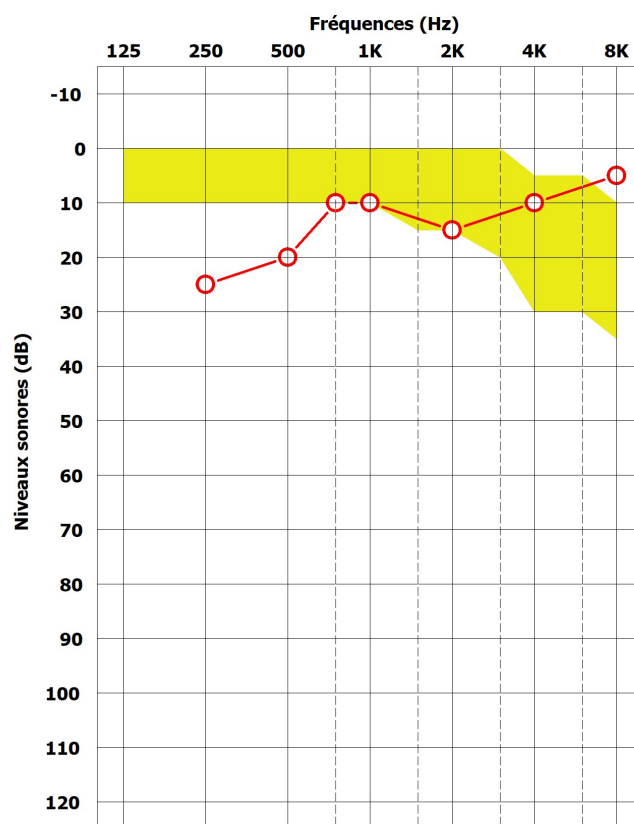

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	5		10		15		10
CA Droit		25	20	10	10		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes