

MEDVIE

Date du test: 10/01/2025 16:50:05

Durée: 6mn 25s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **LAMAH JEAN FRANCOIS**

Date de naissance 04/01/1984

Age 41

Société SMFG


ID 25011016431548339

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

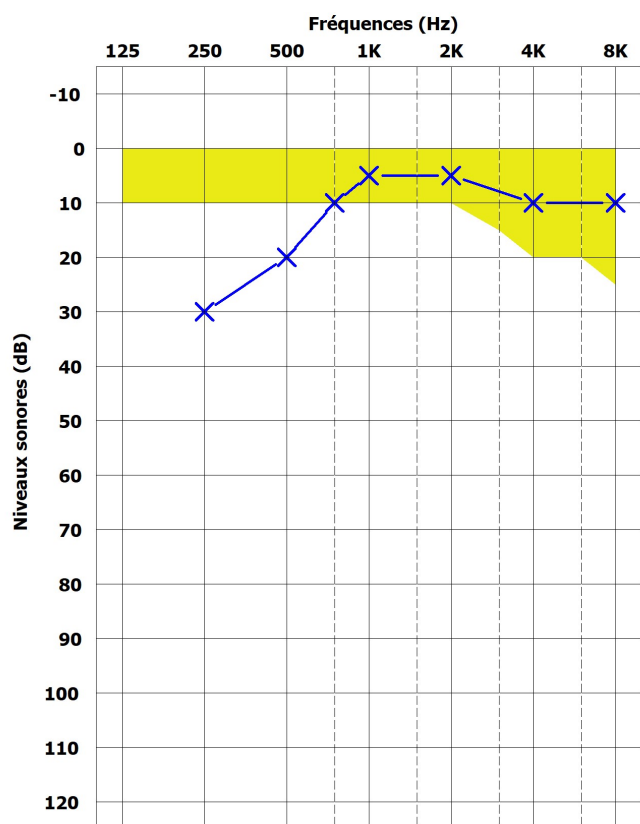

Oreille Gauche

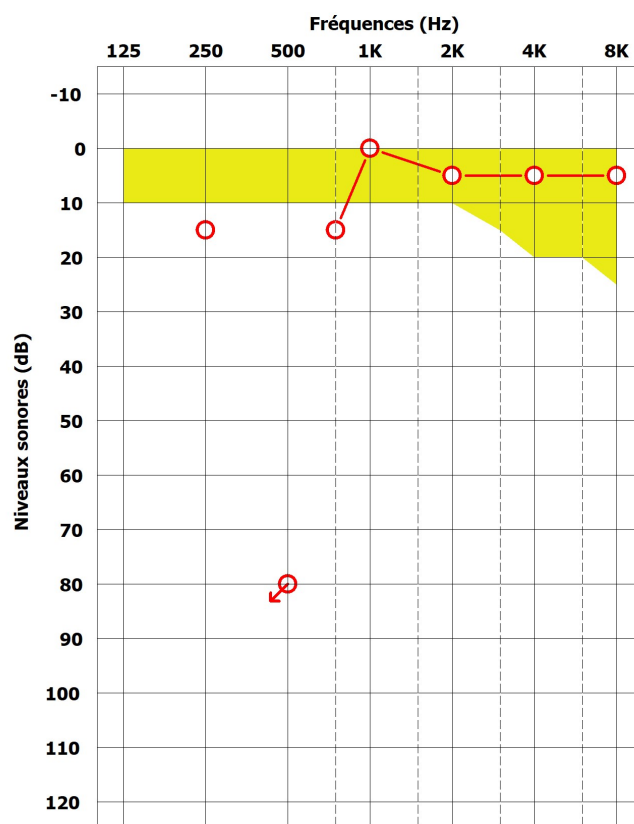

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	10	5		5		10		10
CA Droit		15	(80)	15	0		5		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	---	---

Notes