

MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 13:02:57

Durée: 4mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE LAH NAMALO	
Date de naissance	03/09/1968
Age	56
Société	SMFG
ID	25011012573887290

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

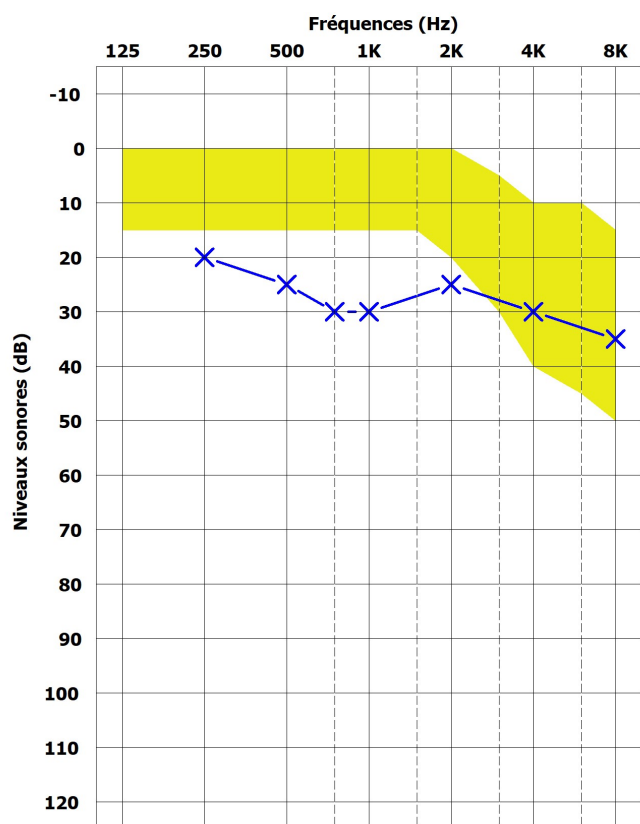

Oreille Gauche

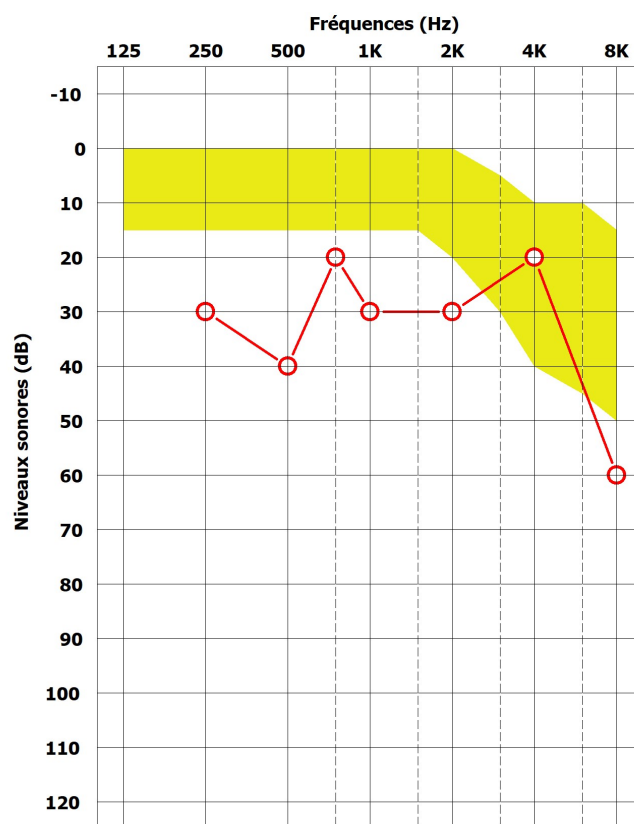

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	30	30		25		30		35
CA Droit		30	40	20	30		30		20		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes