

MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 16:09:07

Durée: 5mn 20s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAMBA SEINAN	
Date de naissance	05/08/1978
Age	46
Société	SMFG
ID	25011016065828076

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

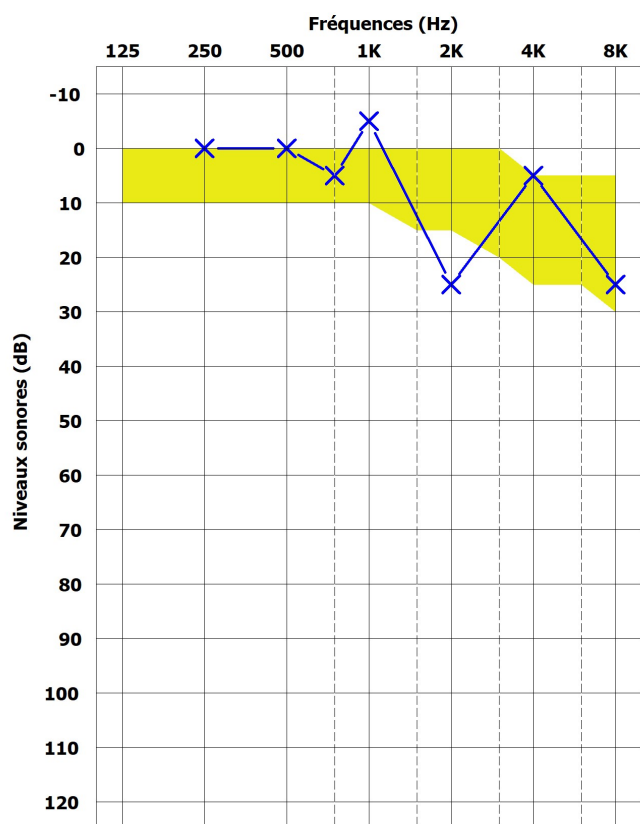

Oreille Gauche

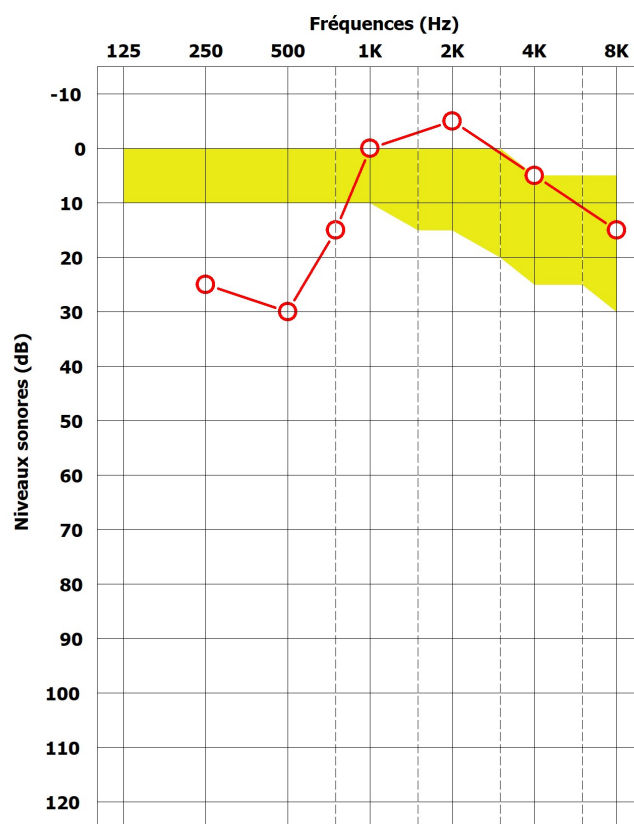

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0	5	-5		25		5		25
CA Droit		25	30	15	0		-5		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes