


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 13:17:52
Durée: 7mn 29s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	NINAMOU DIDI ELOI
Date de naissance	01/07/1970
Age	54
Société	SMFG
ID	25011013145519169

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

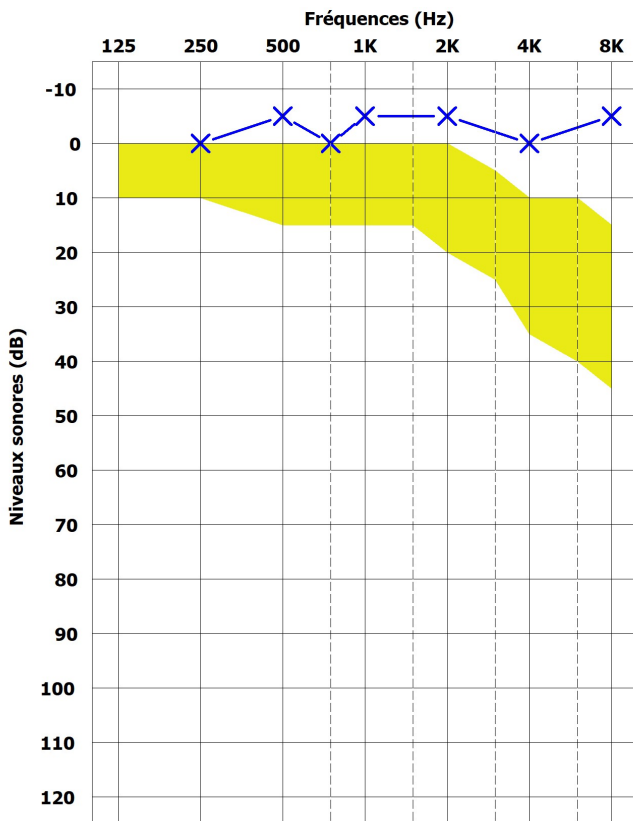

Oreille Gauche

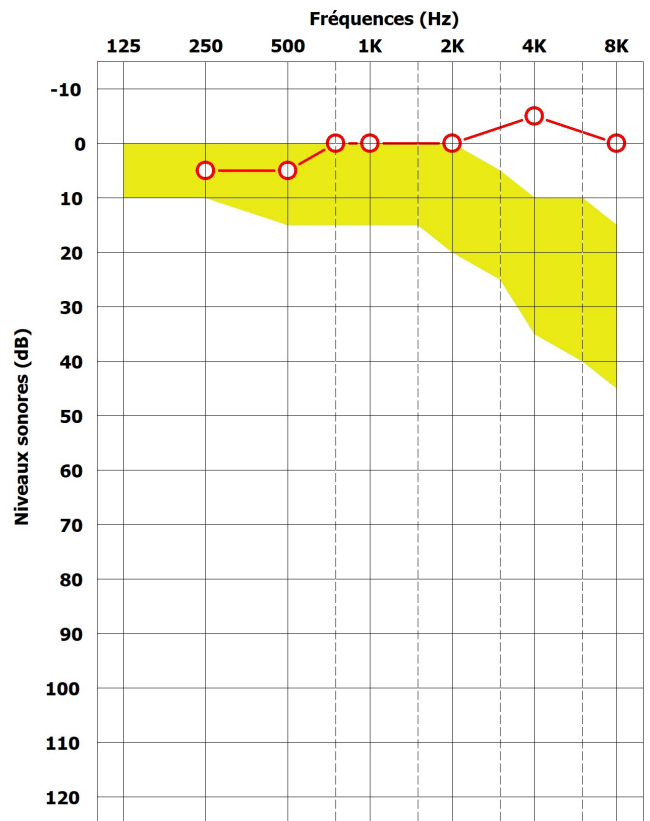

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	-5	0	-5		-5		0		-5
CA Droit		5	5	0	0		0		-5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-3,8 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes