


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 16:58:53
Durée: 2mn 54s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
ΚΡΟΥΘΗΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ	
Date de naissance	07/01/1978
Age	47
Société	SMFG
ID	25011016391157175

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

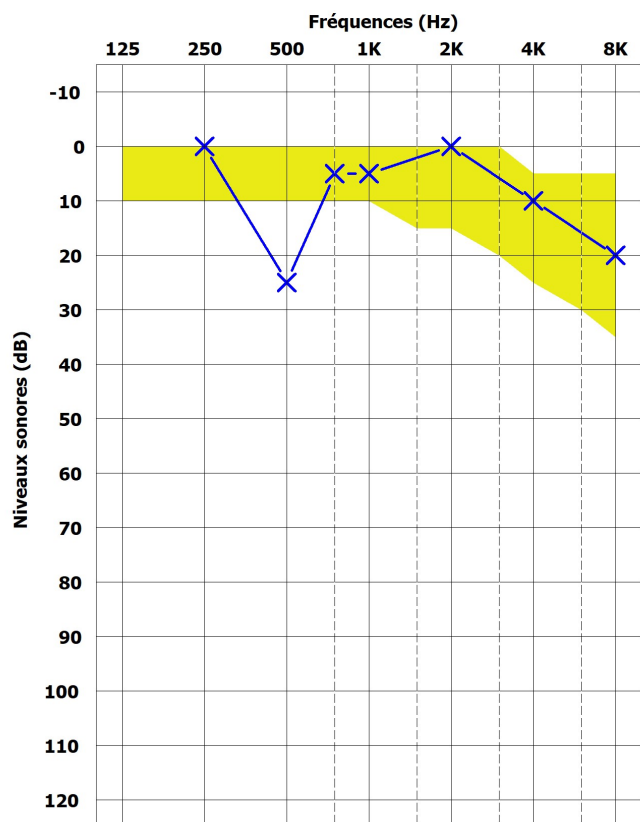

Oreille Gauche

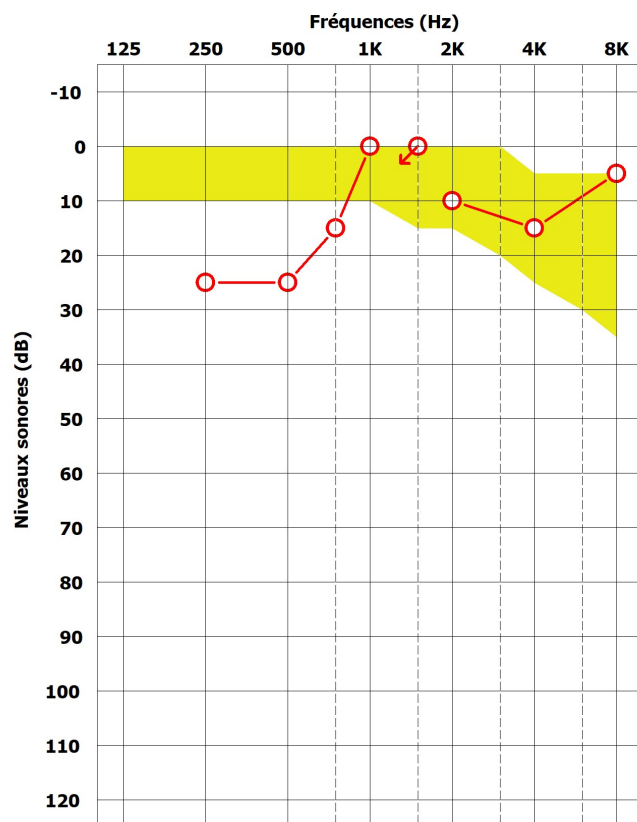

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	25	5	5		0		10		20
CA Droit		25	25	15	0	(0)	10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes