

MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 16:27:44

Durée: 4mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DORE ROGER
Date de naissance	12/10/1975
Age	49
Société	SMFG
ID	25011016253687405

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

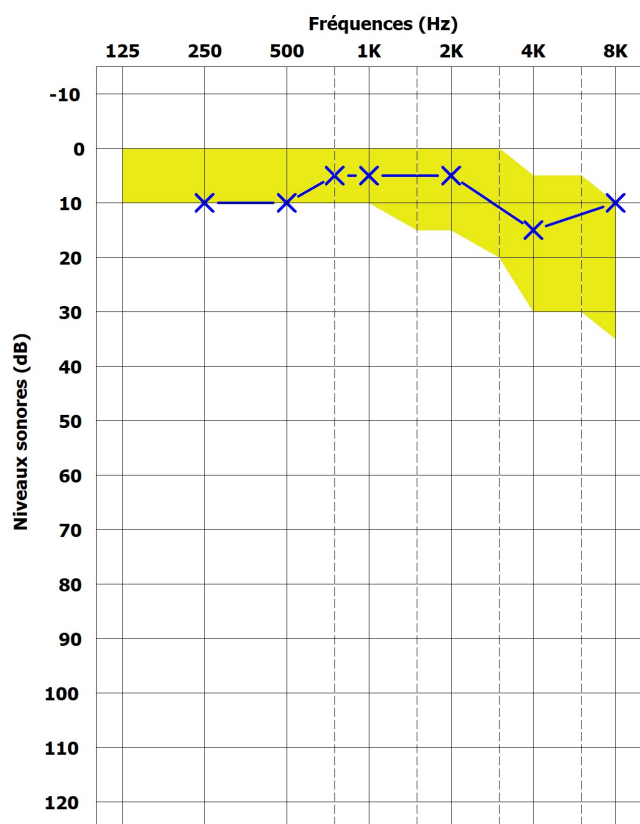

Oreille Gauche

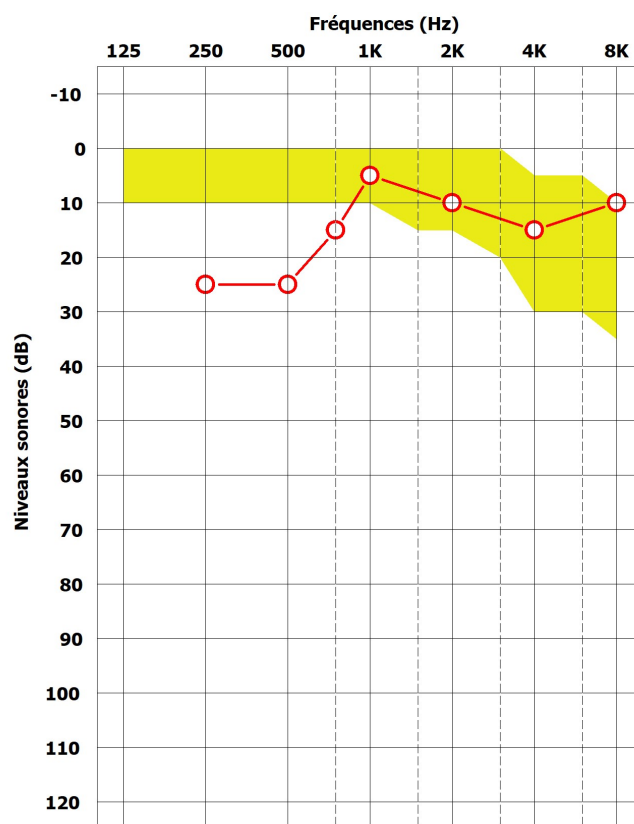

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	5		5		15		10
CA Droit		25	25	15	5		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes