


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 18:24:16
Durée: 4mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
GBAMOU SORY	
Date de naissance	01/01/1977
Age	48
Société	SMFG
ID	25011018215506590

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

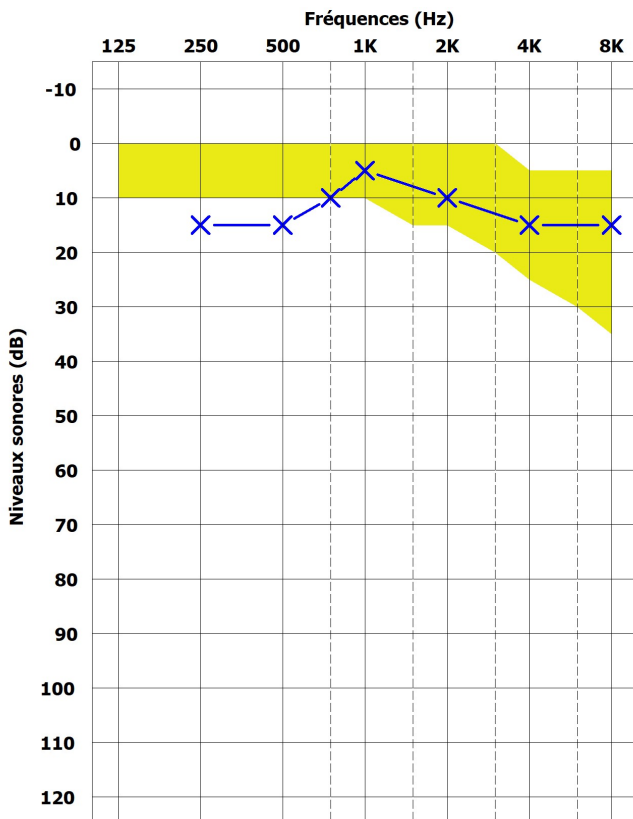

Oreille Gauche

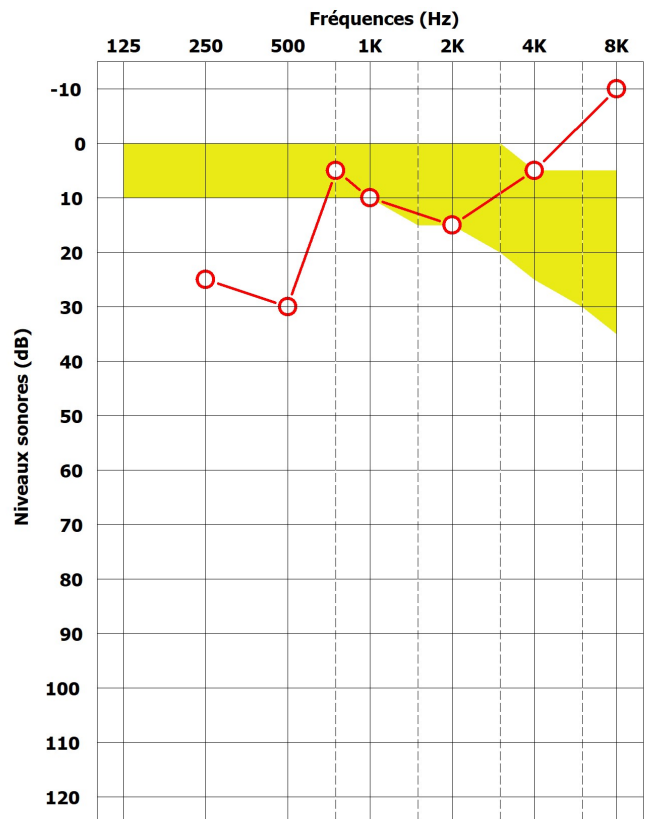

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	5		10		15		15
CA Droit		25	30	5	10		15		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes