


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 15:30:59
Durée: 6mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KINIMY CE GERMAIN	
Date de naissance	22/04/1980
Age	44
Société	SMFG
ID	25011115292573919

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

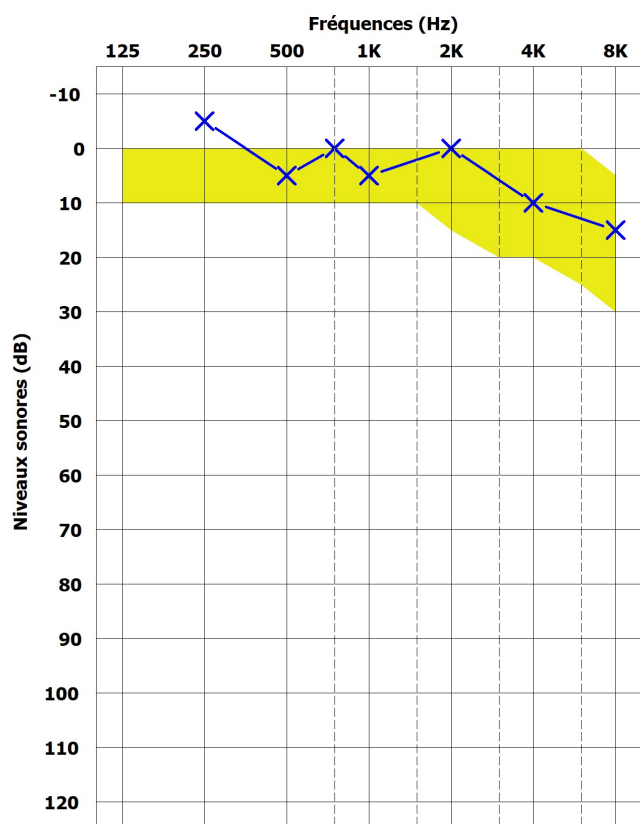

Oreille Gauche

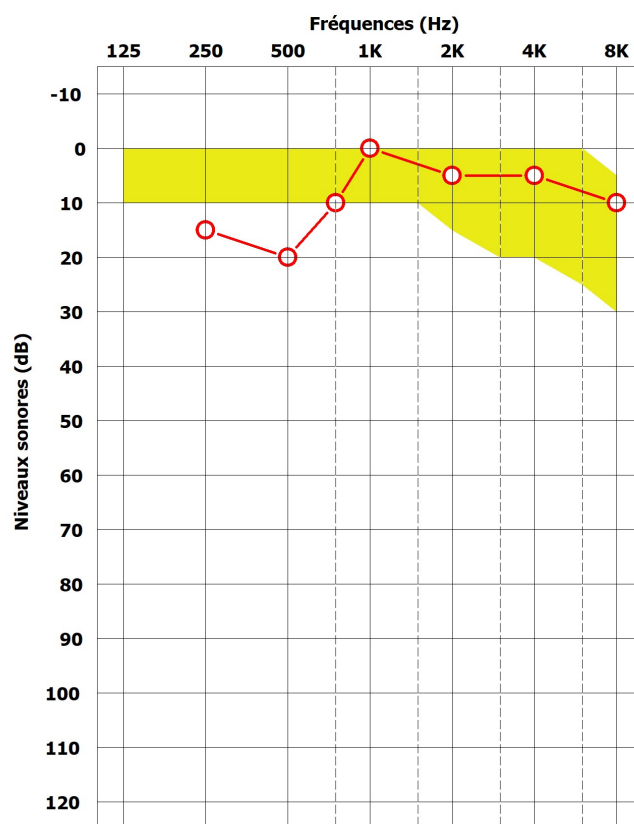

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	0	5		0		10		15
CA Droit		15	20	10	0		5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes