

MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 18:30:34

Durée: 4mn 24s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DORE BENJAMIN	
Date de naissance	01/01/1982
Age	43
Société	SMFG
ID	25011018243574087

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

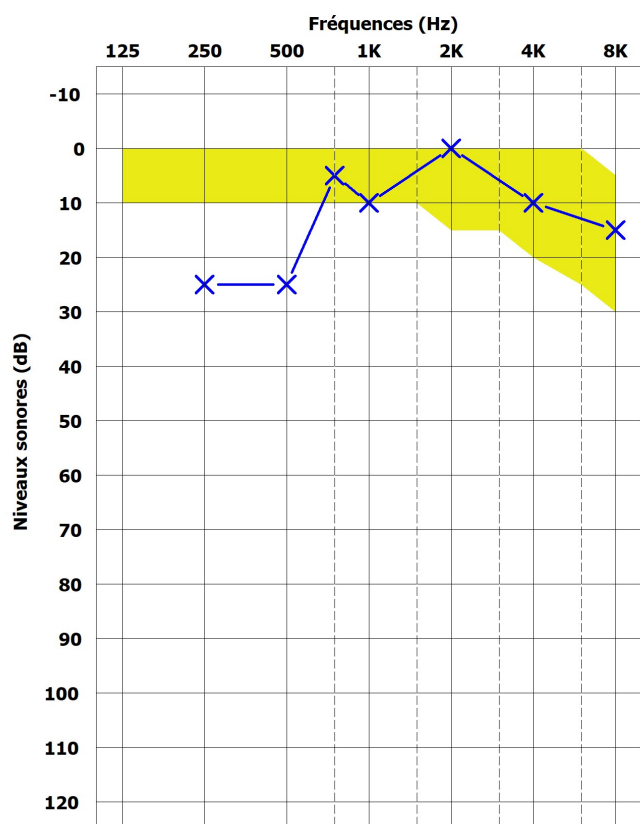

Oreille Gauche

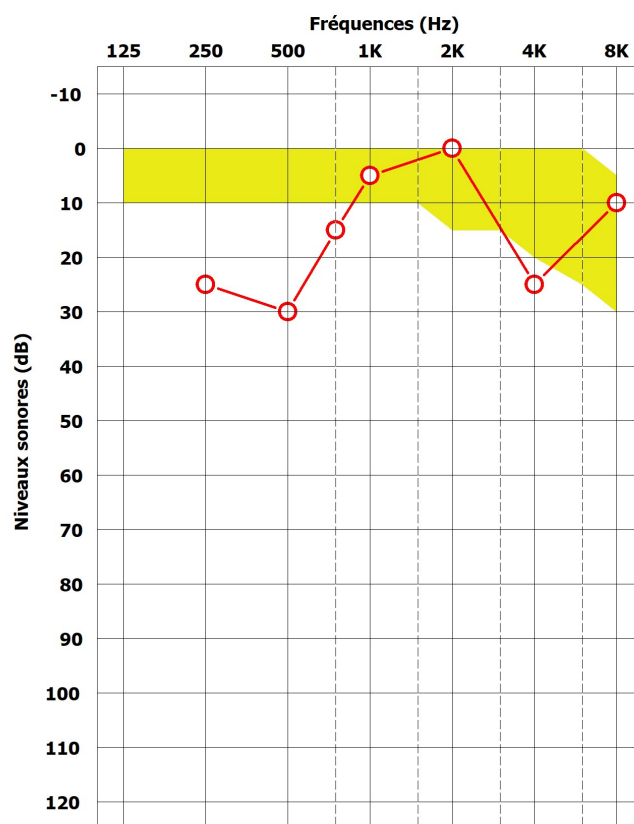

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	5	10		0		10		15
CA Droit		25	30	15	5		0		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes