


MEDVIE

Date du test: 10/01/2025 16:34:53

Durée: 4mn 43s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

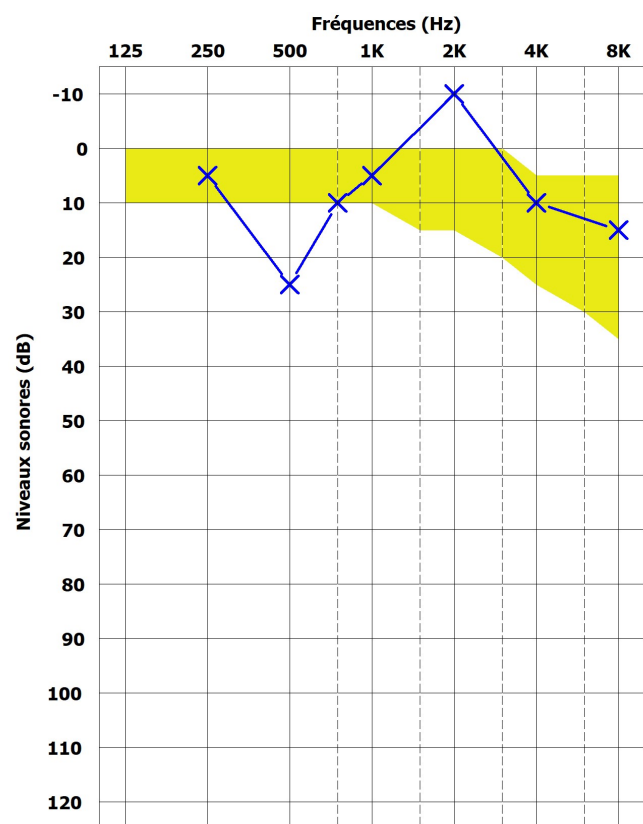

Oreille Gauche

| Données Patient    |                   |
|--------------------|-------------------|
| DORE EMMANUEL GOTE |                   |
| Date de naissance  | 07/01/1978        |
| Age                | 47                |
| Société            | SMFG              |
| ID                 | 25011016391157175 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

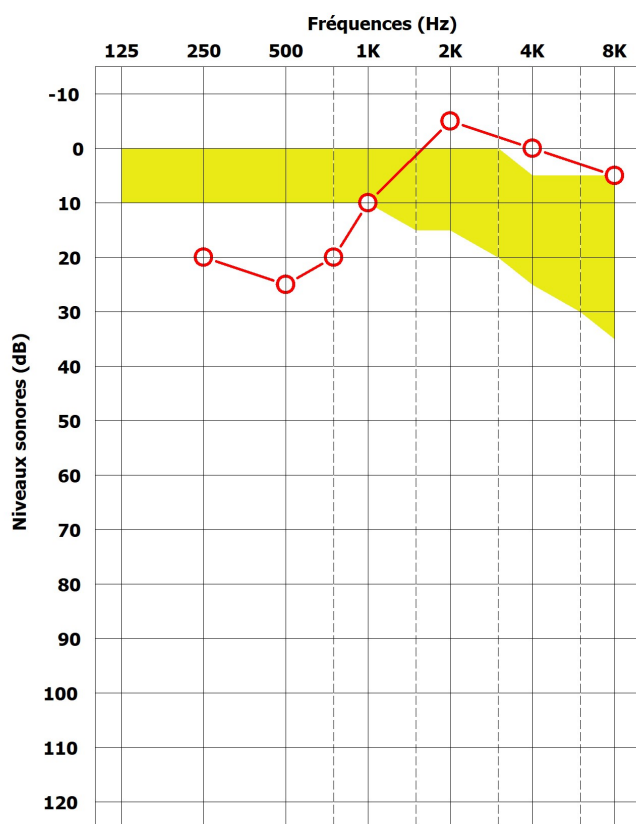

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k  | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 25  | 10  | 5  |     | -10 |    | 10 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 20  | 25  | 20  | 10 |     | -5  |    | 0  |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB | --- |
| CA Droit        | 7,5 dB | --- |

Notes