


MEDVIE


Date du test: 17/01/2025 17:16:00
Durée: 0mn 42s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
GBAMOU MATHO GUILA	
Date de naissance	08/03/1989
Age	35
Société	SMFG
ID	25011111090619953

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

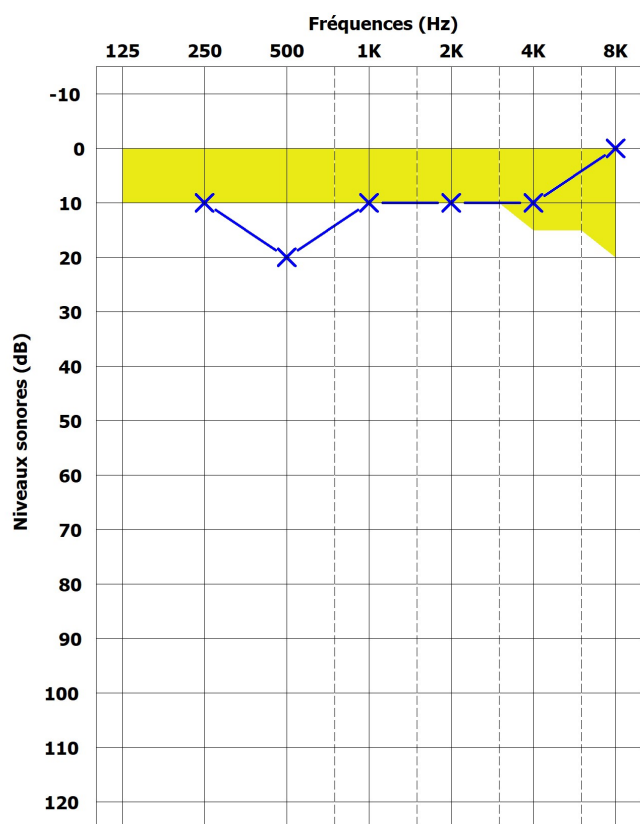

Oreille Gauche

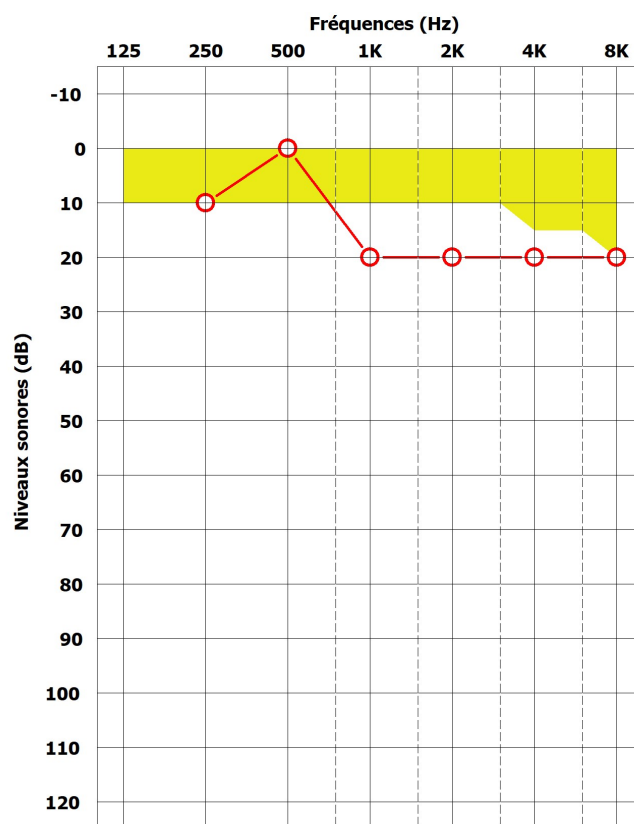

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20		10		10		10		0
CA Droit		10	0		20		20		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes