



Données Patient		DORE CEII
Date de naissance	20/03/1959	
Age	65	
Société	SMFG	
ID	25011012411655526	

Date du test: 10/01/2025 12:43:27
Durée: 5mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

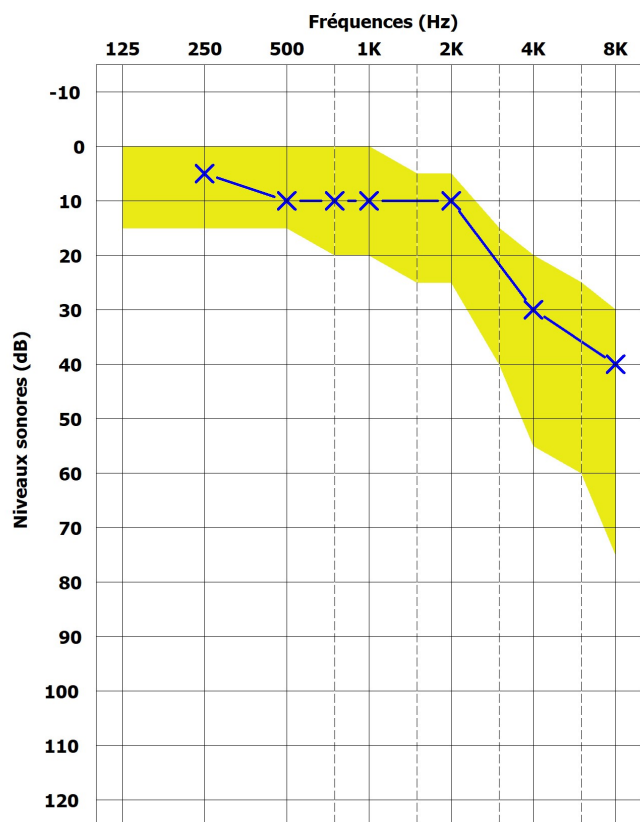

Oreille Gauche

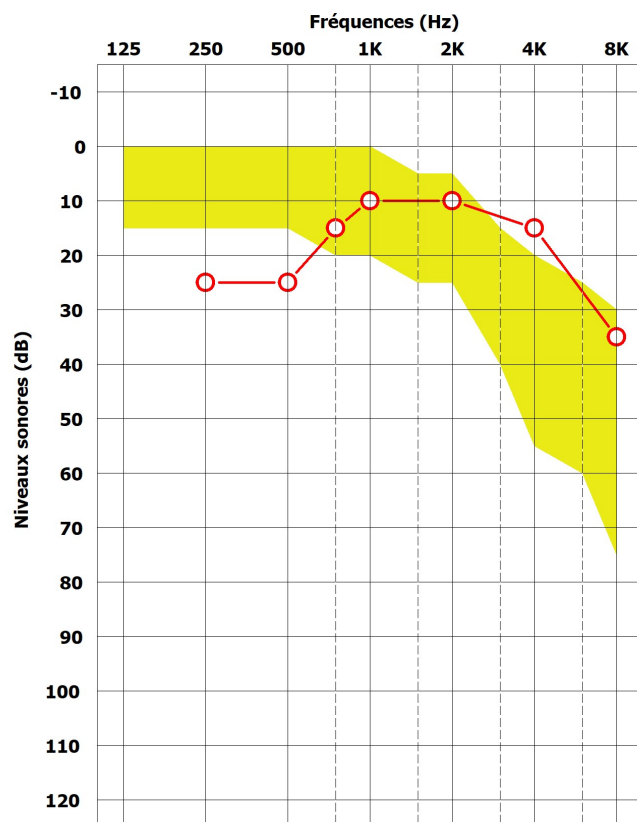

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	10		10		30		40
CA Droit		25	25	15	10		10		15		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes