

MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 10:07:42

Durée: 4mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SACKO MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1994
Age	31
Société	KAS EXPRESS
ID	25031810054695946

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

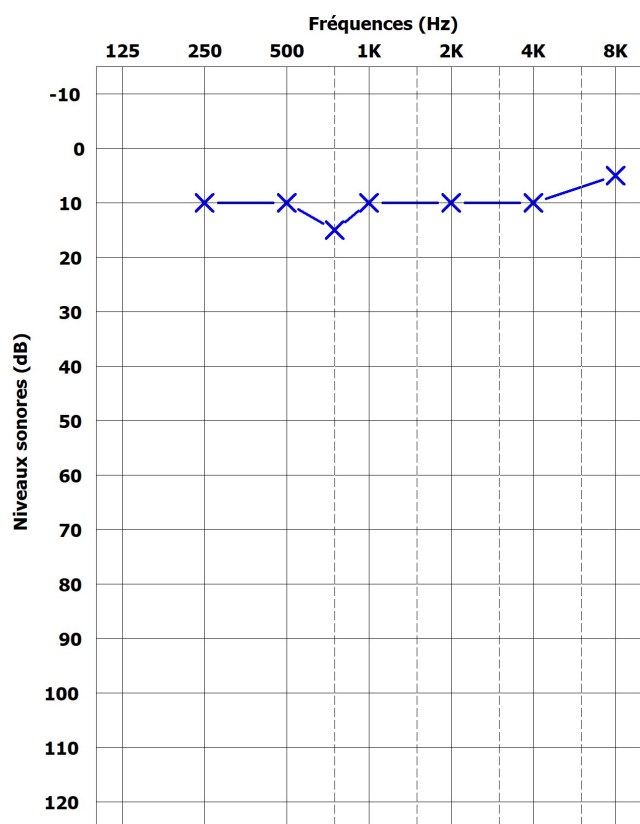

Oreille Gauche

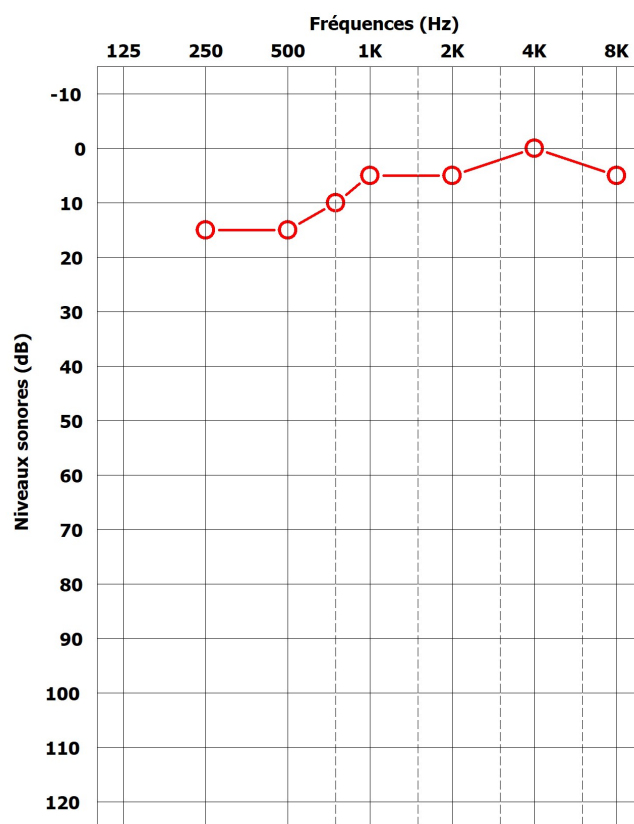

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	10		10		10		5
CA Droit		15	15	10	5		5		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes