

MEDVIE


Date du test: 23/07/2025 11:17:49

Durée: 4mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SOUMAH ABDOULAYE
Date de naissance	01/10/2002
Age	22
Société	KAS EXPRES
ID	25072309493490073

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

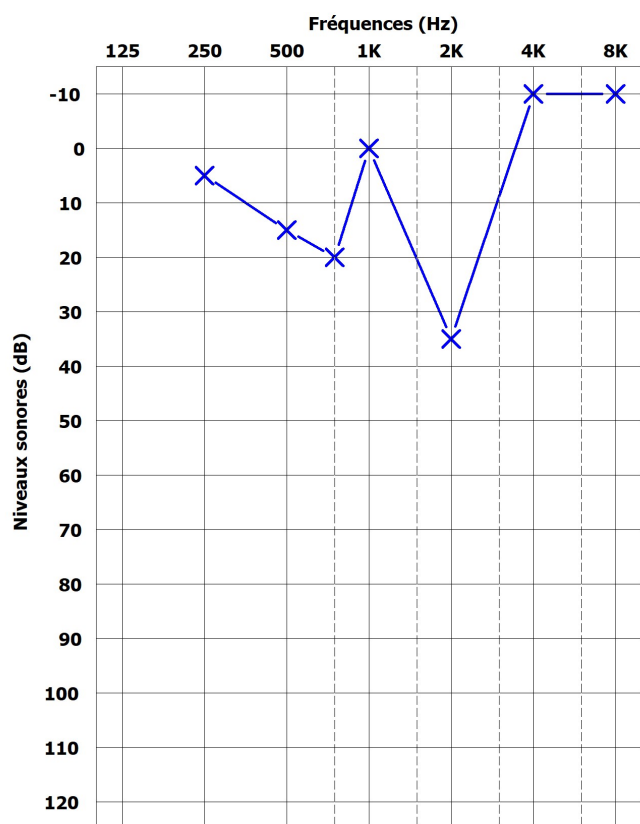

Oreille Gauche

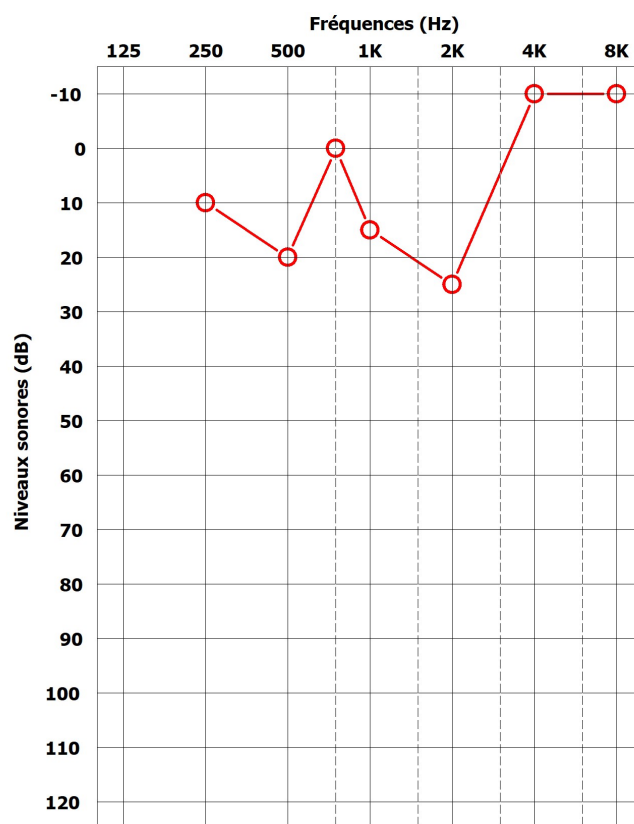

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	20	0		35		-10		-10
CA Droit		10	20	0	15		25		-10		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes