


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 17:35:35
Durée: 5mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE IBRAHIMA
Date de naissance	26/02/1980
Age	44
Société	ADEN
ID	25011017291158768

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

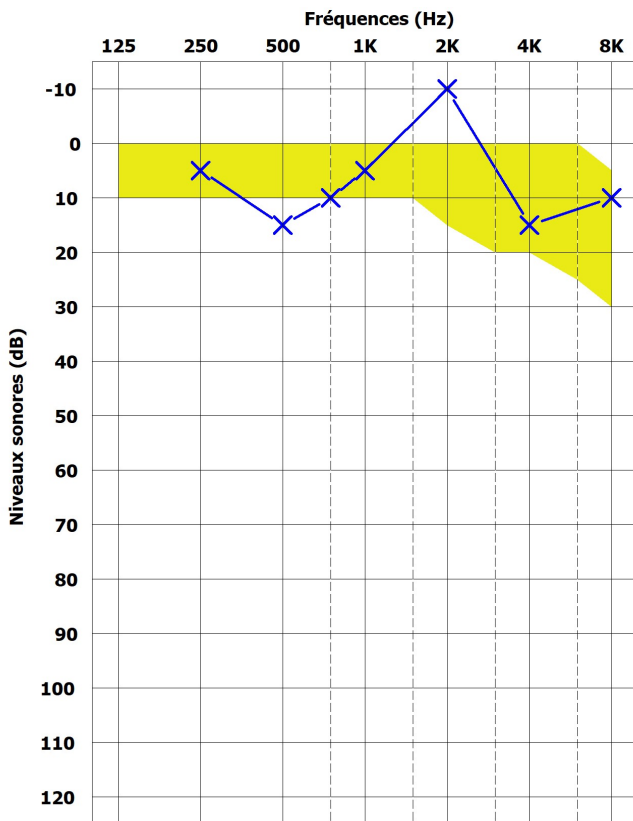

Oreille Gauche

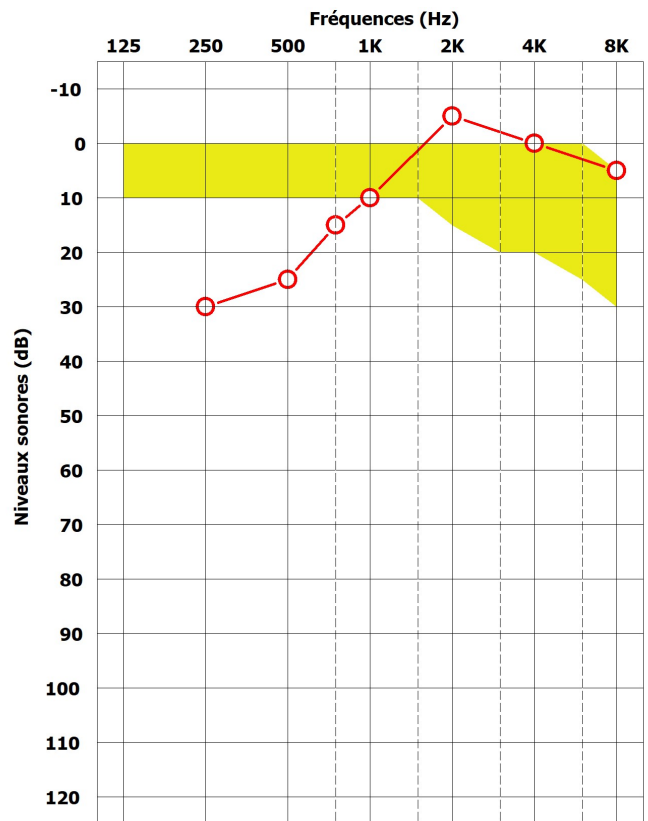

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	10	5		-10		15		10
CA Droit		30	25	15	10		-5		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes