


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 16:57:26
Durée: 3mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA NIANGA	
Date de naissance	01/12/1987
Age	37
Société	ADEN
ID	25011116553047409

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

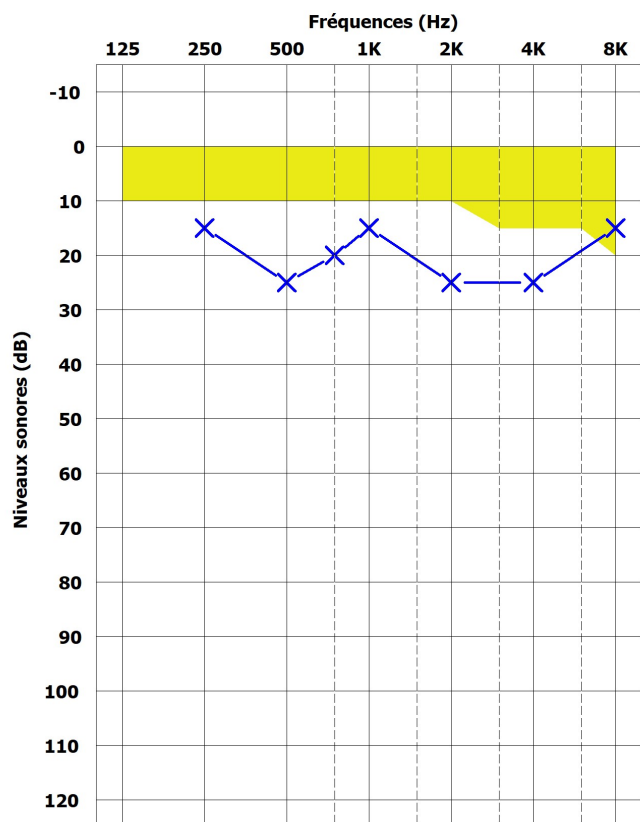

Oreille Gauche

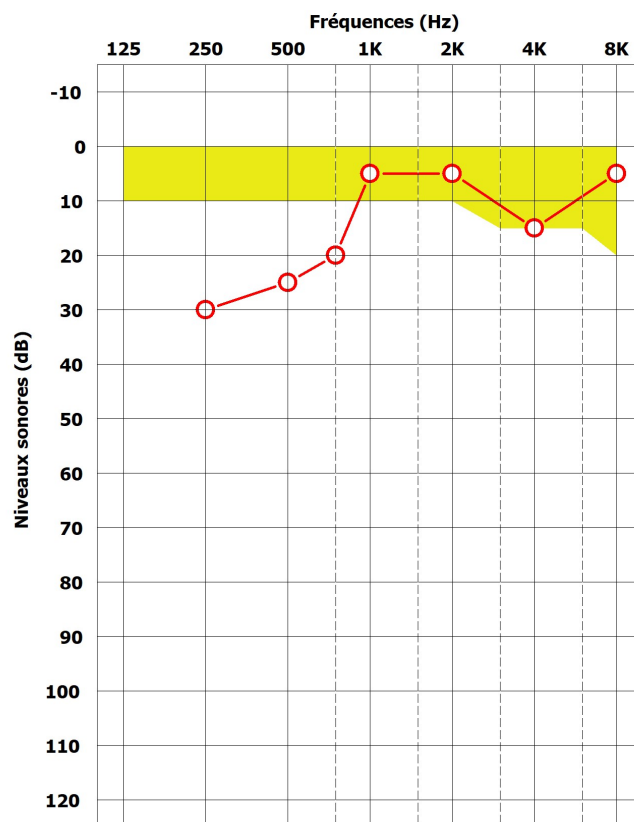

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	20	15		25		25		15
CA Droit		30	25	20	5		5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes