

MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 14:09:32

Durée: 6mn 00s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>MAOMOU ALPHONSE</b> |                   |
| Date de naissance      | 22/04/1980        |
| Age                    | 44                |
| Société                | ADEN              |
| ID                     | 25011014040218502 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

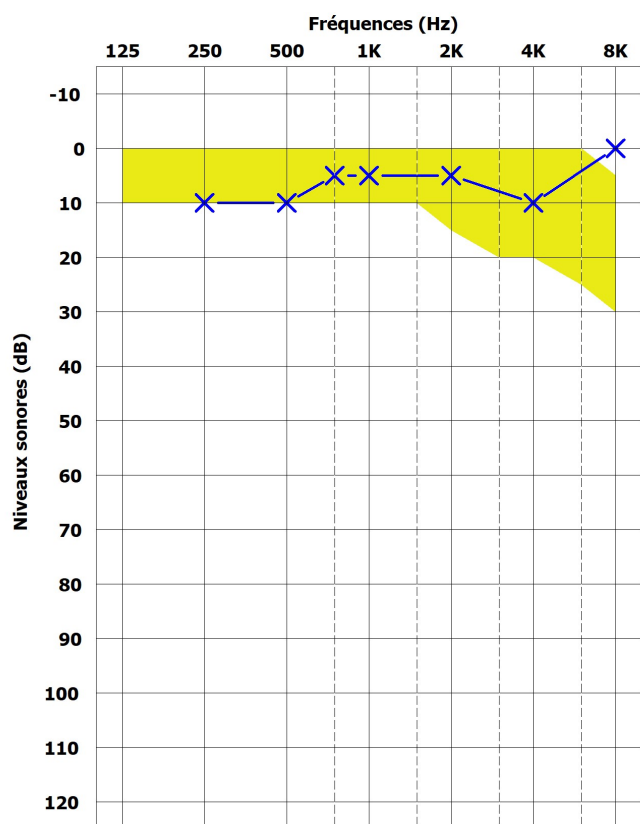

Oreille Gauche

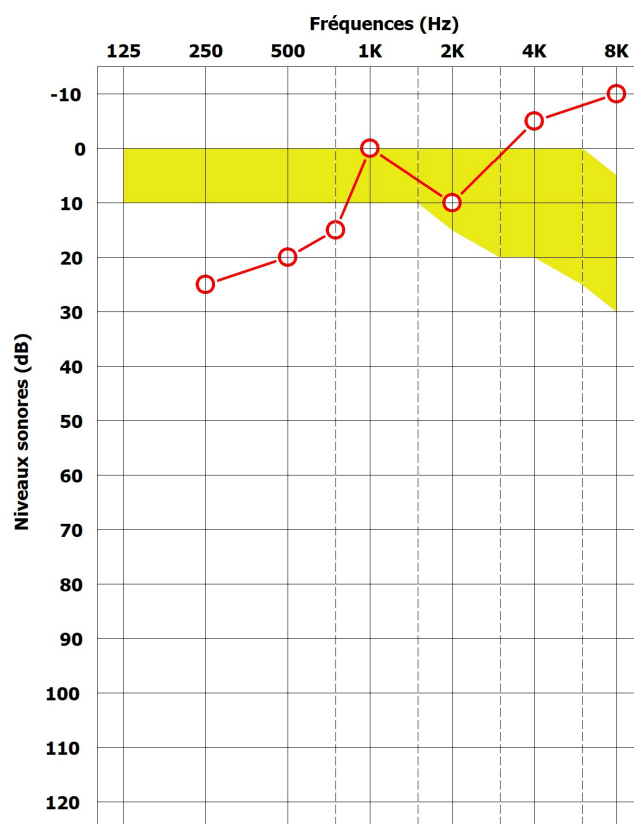

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | 10  | 10  | 5   | 5  |     | 5  |    | 10 |    | 0   |
| CA Droit  |     | 25  | 20  | 15  | 0  |     | 10 |    | -5 |    | -10 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB | --- |
| CA Droit        | 6,3 dB | --- |

Notes