


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 12:30:37
Durée: 4mn 57s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
LAMAH HELENE	
Date de naissance	14/08/1992
Age	32
Société	ADEN
ID	25011012290430259

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

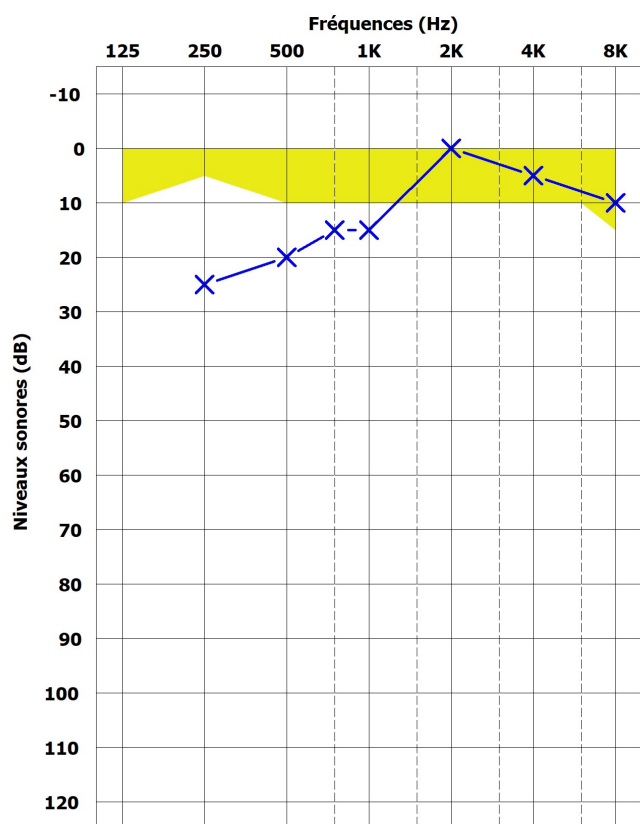

Oreille Gauche

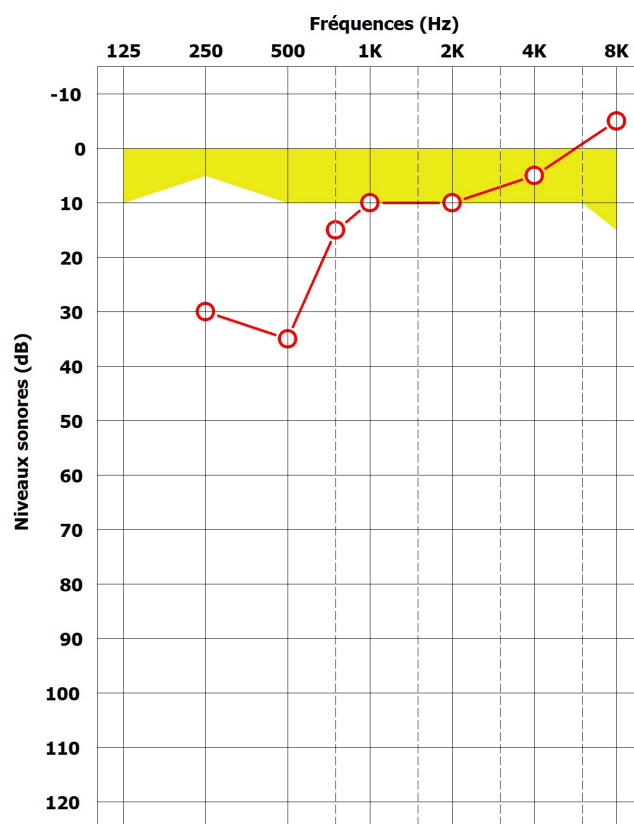

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	15		0		5		10
CA Droit		30	35	15	10		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes