

MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 13:42:13

Durée: 4mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MAMY AMADOU	
Date de naissance	01/07/1979
Age	45
Société	ADEN
ID	25011113314954740

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

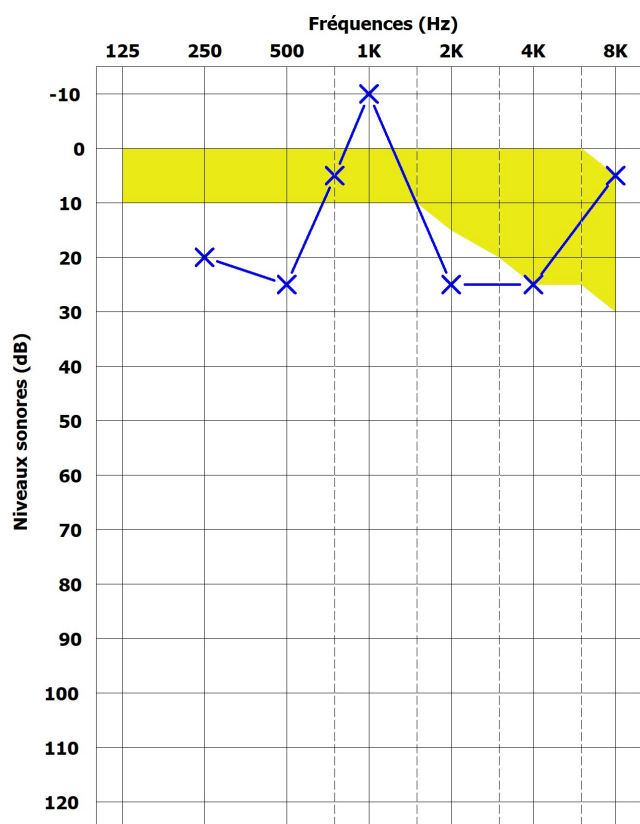

Oreille Gauche

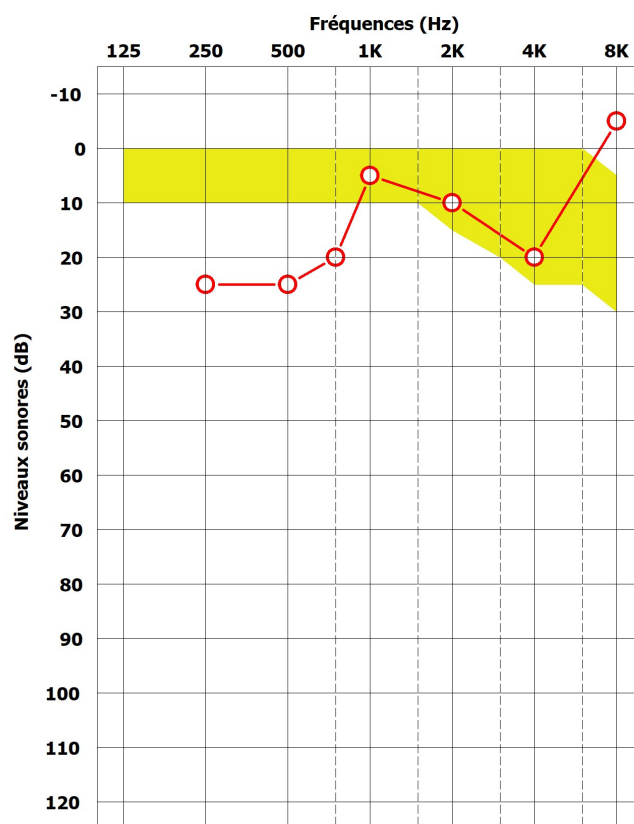

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	5	-10		25		25		5
CA Droit		25	25	20	5		10		20		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes