

MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 10:47:44

Durée: 6mn 03s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOIVOGUI KEBE	
Date de naissance	01/01/1986
Age	39
Société	ADEN
ID	25011110455750835

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

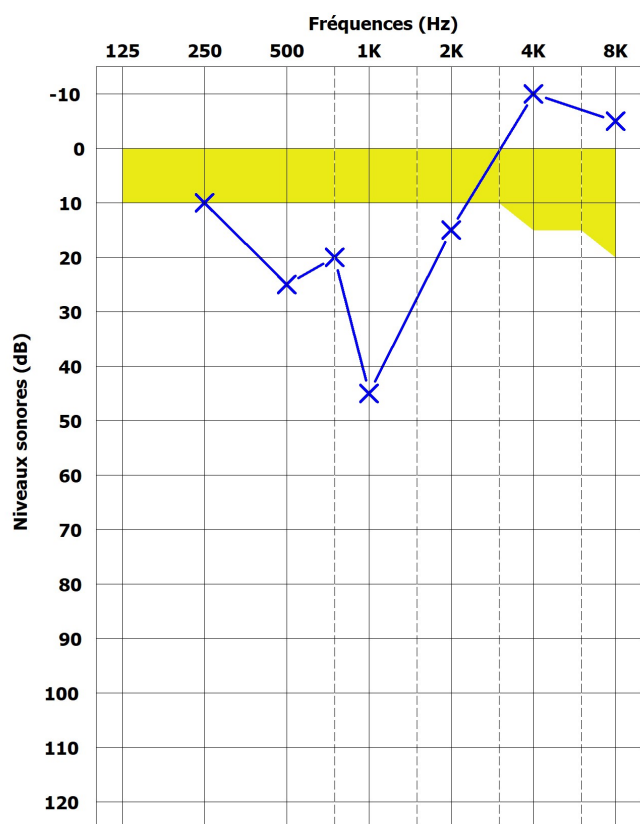

Oreille Gauche

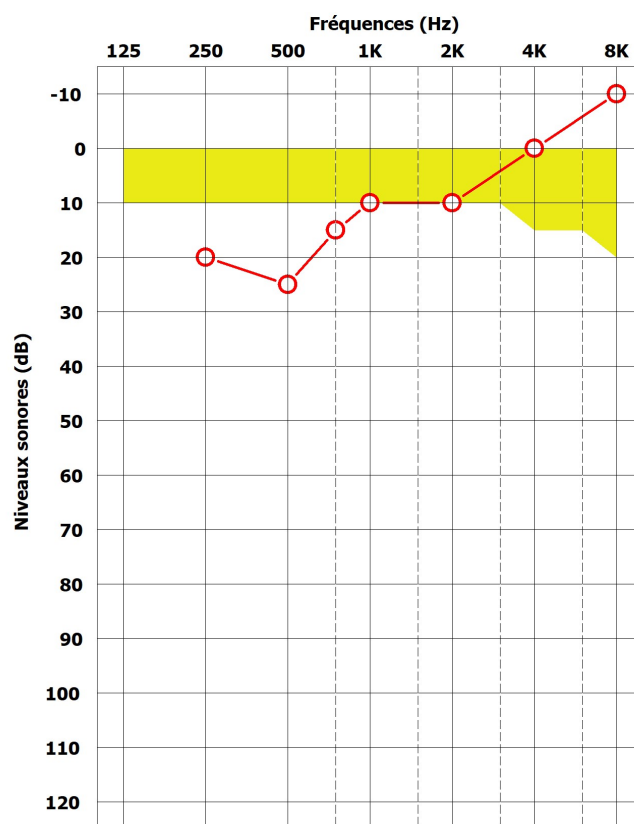

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	20	45		15		-10		-5
CA Droit		20	25	15	10		10		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes