


MEDVIE


Date du test: 13/01/2025 10:25:07
Durée: 6mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MICHEL	
Date de naissance	31/12/1986
Age	38
Société	ADEN
ID	25011310231863152

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

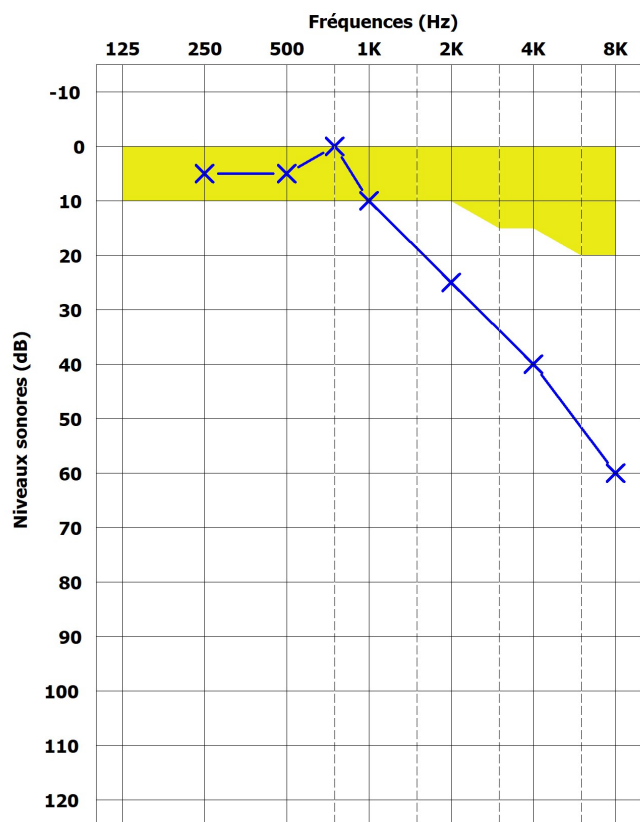

Oreille Gauche

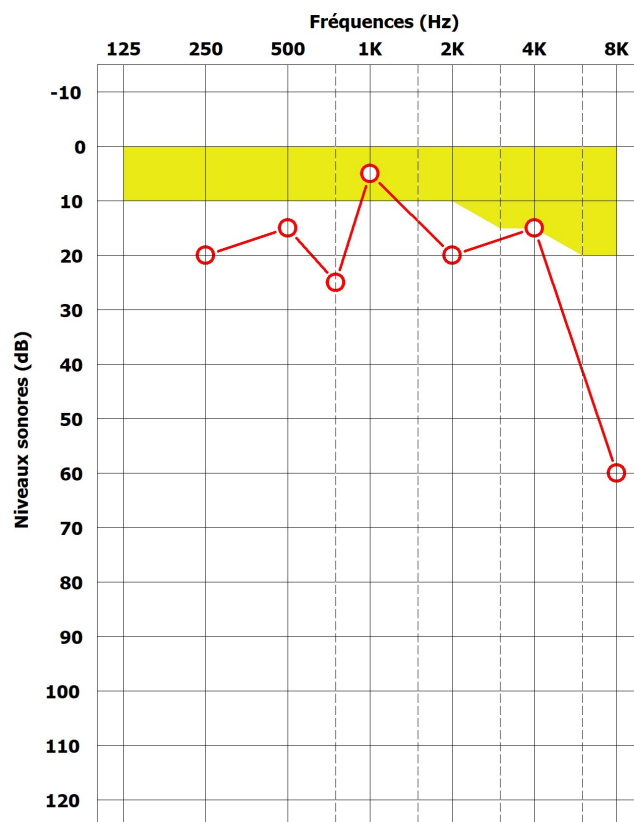

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	0	10		25		40		60
CA Droit		20	15	25	5		20		15		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes