

MEDVIE


Date du test: 13/01/2025 09:17:06

Durée: 5mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BAMBA MATHOS
Date de naissance	29/09/1983
Age	41
Société	ADEN
ID	25011309141183927

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

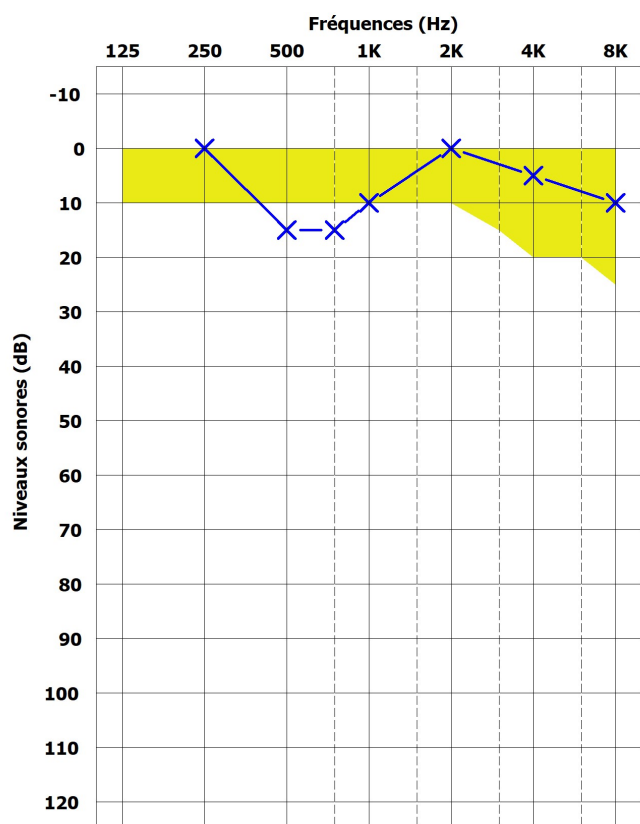

Oreille Gauche

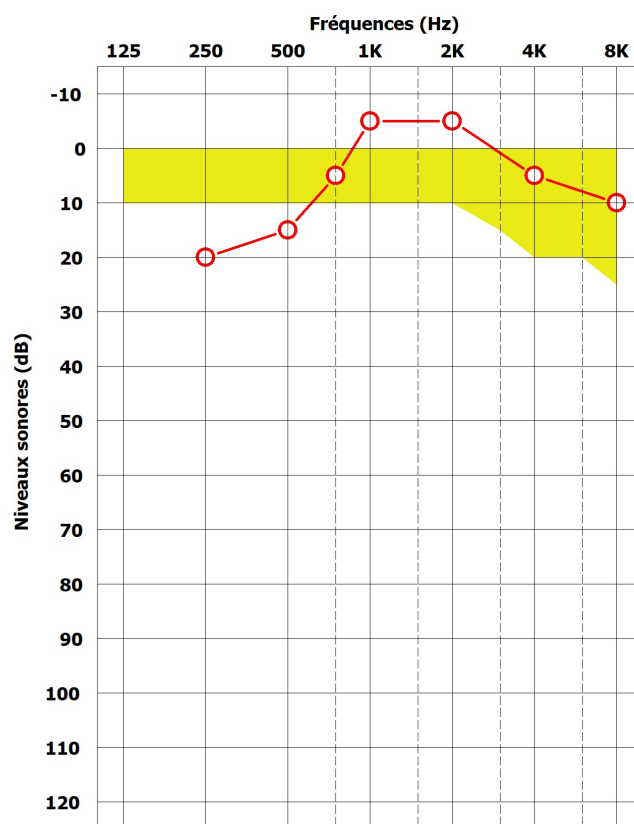

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15	15	10		0		5		10
CA Droit		20	15	5	-5		-5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes