


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 10:56:19
Durée: 4mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		GROVOGUI KEBE
Date de naissance	07/03/1986	
Age	38	
Société	SMFG	
ID	25011110533831688	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

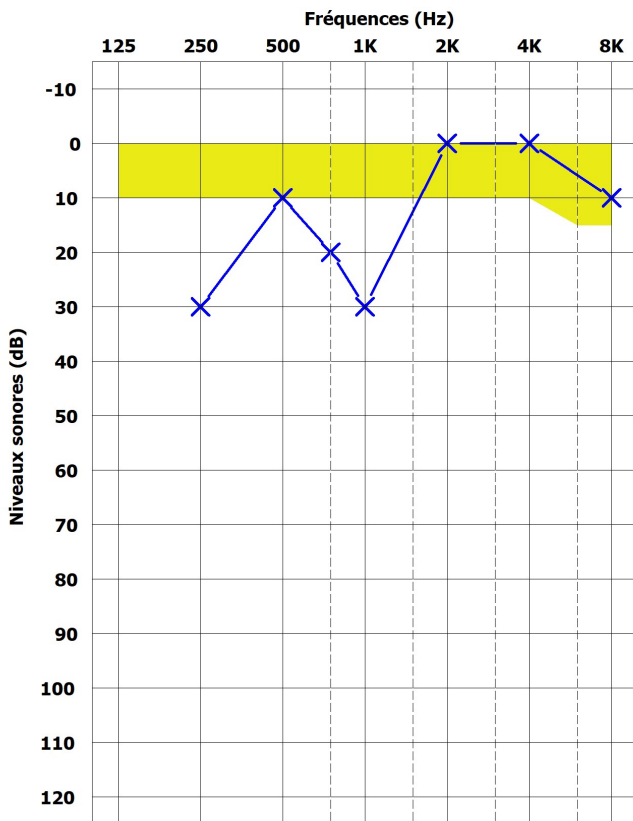

Oreille Gauche

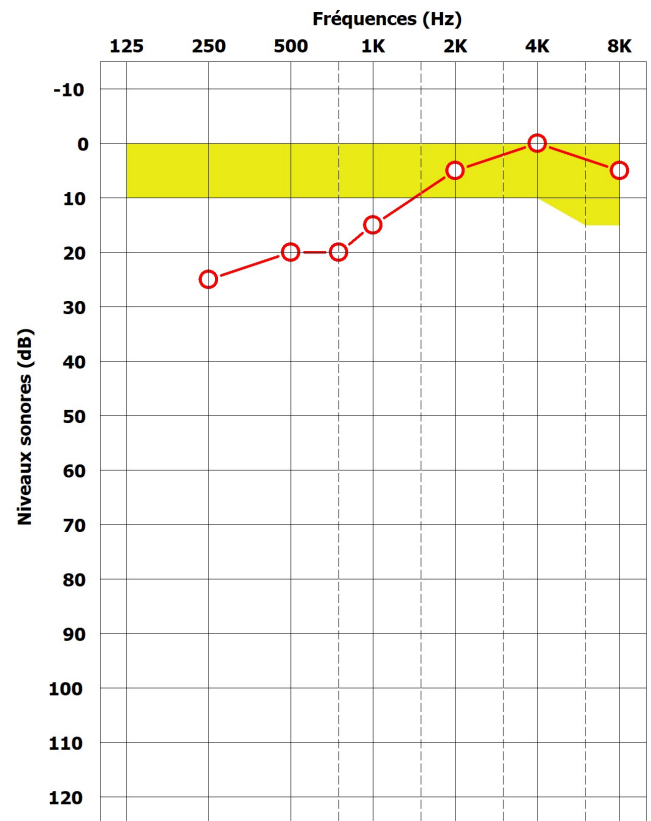

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	10	20	30		0		0		10
CA Droit		25	20	20	15		5		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes