


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 11:58:36
Durée: 9mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOLIE ZAORO	
Date de naissance	28/03/1975
Age	49
Société	ADEN
ID	25011011564363925

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

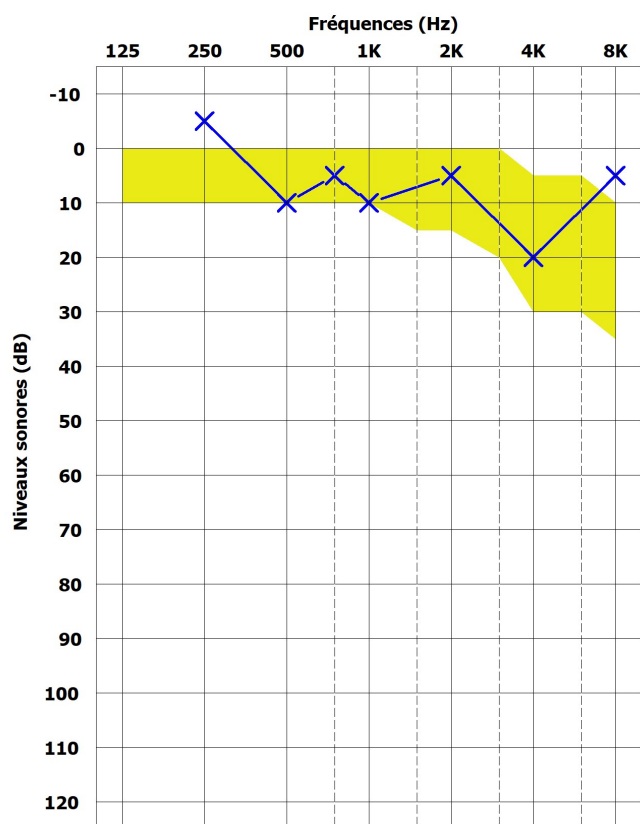

Oreille Gauche

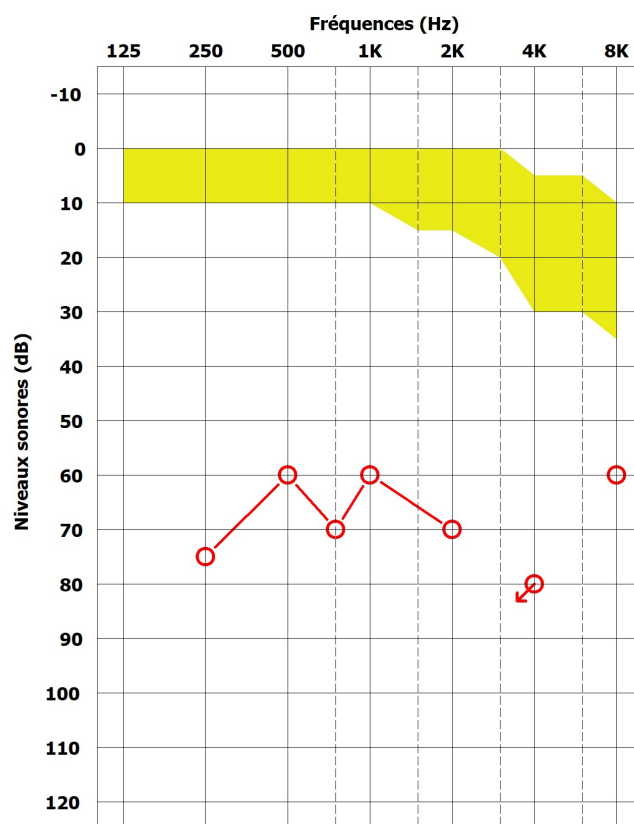

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10	5	10		5		20		5
CA Droit		75	60	70	60		70		(80)		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	---	---

Notes