

Données Patient

SACKO GNAME

Date de naissance 10/02/1990
Age 34
Société ADEN
ID 25011110062522689


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 11/01/2025 10:13:31

Durée: 4mn 02s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

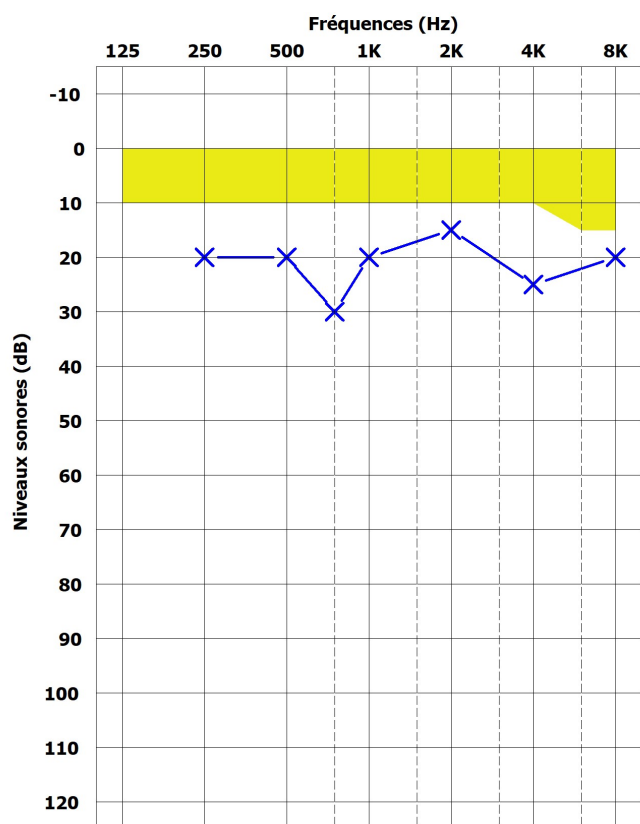

Oreille Gauche

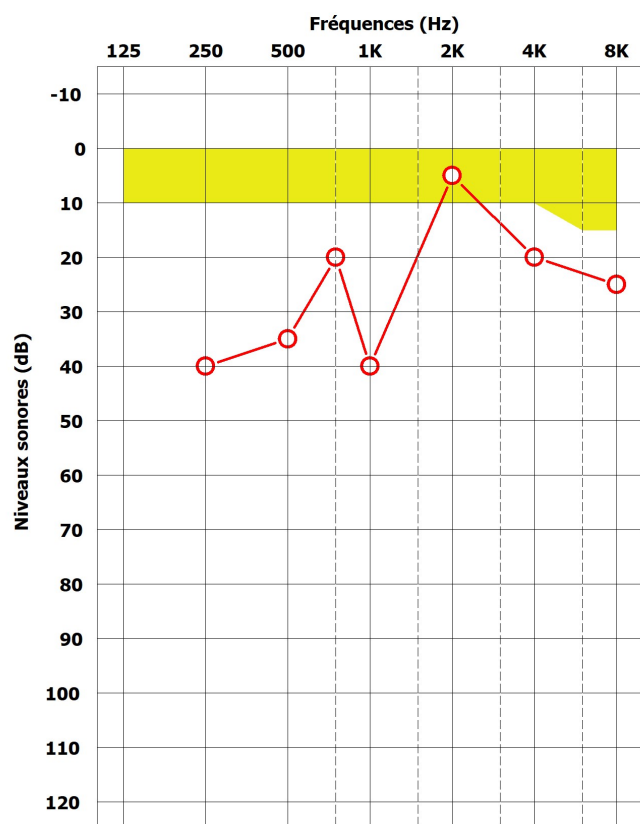

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	30	20		15		25		20
CA Droit		40	35	20	40		5		20		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes