


MEDVIE


Date du test: 13/01/2025 08:57:08
Durée: 3mn 42s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
OULARE YOUSOUF	
Date de naissance	02/06/1977
Age	47
Société	ADEN
ID	25011308550669348

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

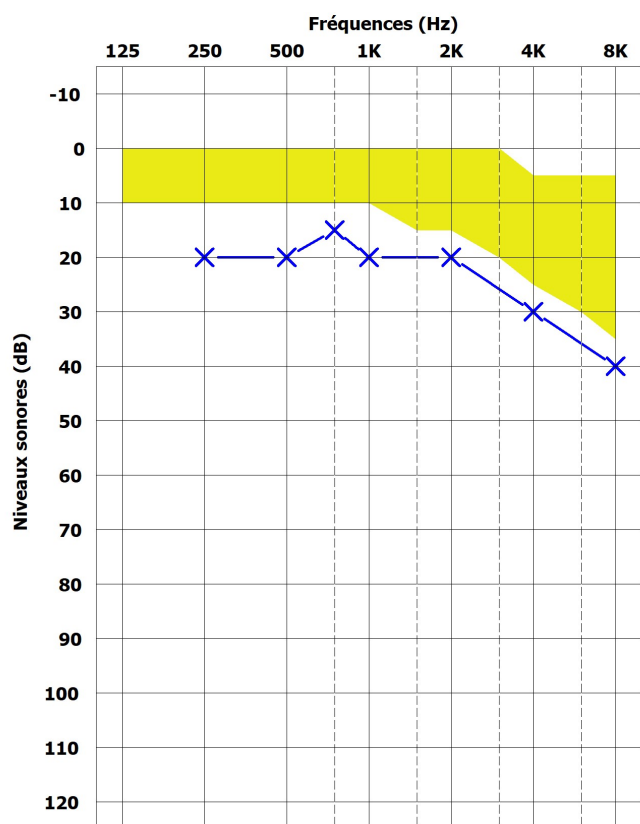

Oreille Gauche

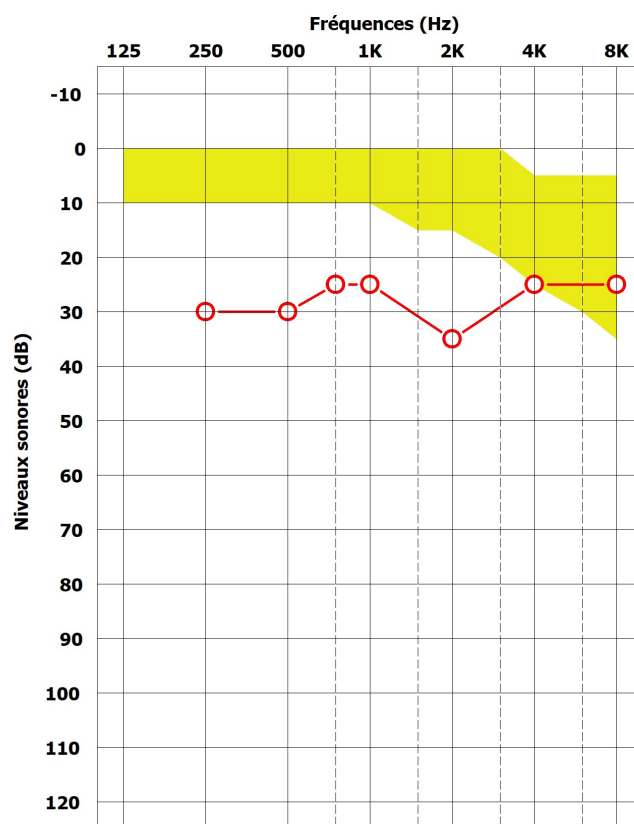

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	20		20		30		40
CA Droit		30	30	25	25		35		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes