


MEDVIE


Date du test: 10/01/2025 14:34:16
Durée: 5mn 16s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	MALE ANIE
Date de naissance	01/01/1976
Age	49
Société	ADEN
ID	25011014190781071

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

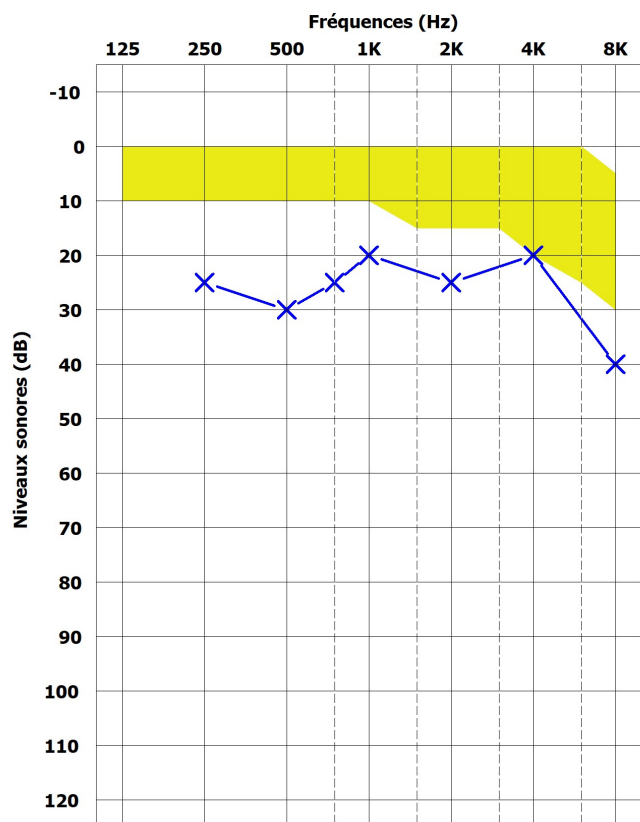

Oreille Gauche

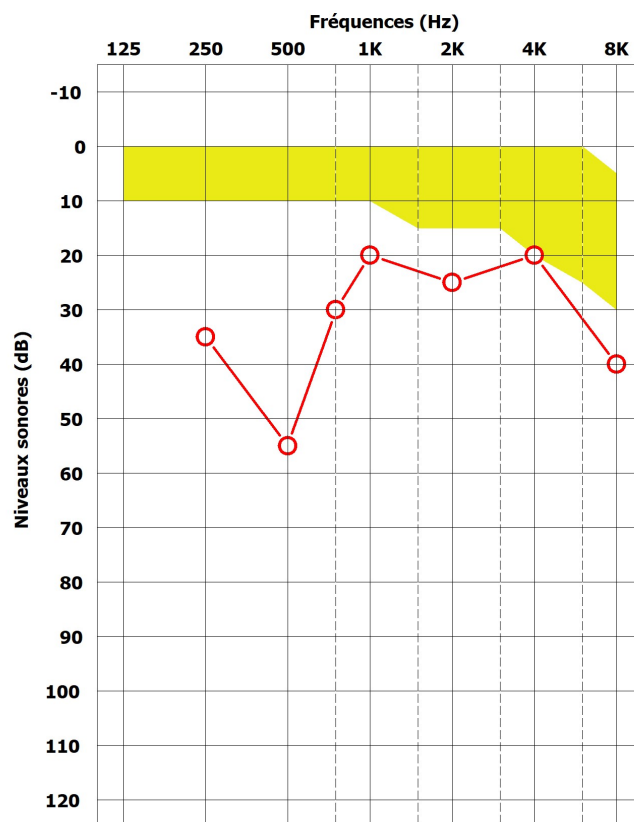

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	20		25		20		40
CA Droit		35	55	30	20		25		20		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes