


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 13:30:21
Durée: 4mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUNAMOU BERTIN	
Date de naissance	01/01/1967
Age	58
Société	EGAS
ID	25011113262469050

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

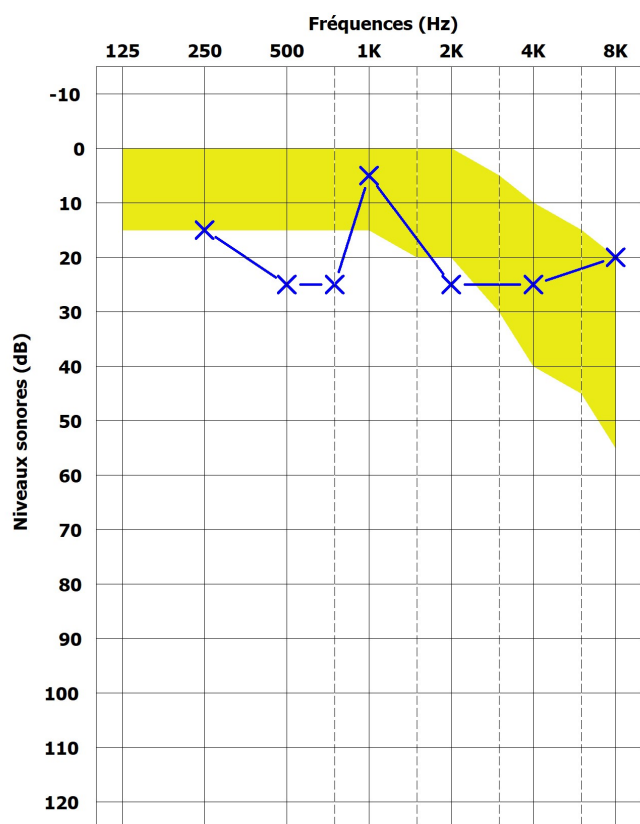

Oreille Gauche

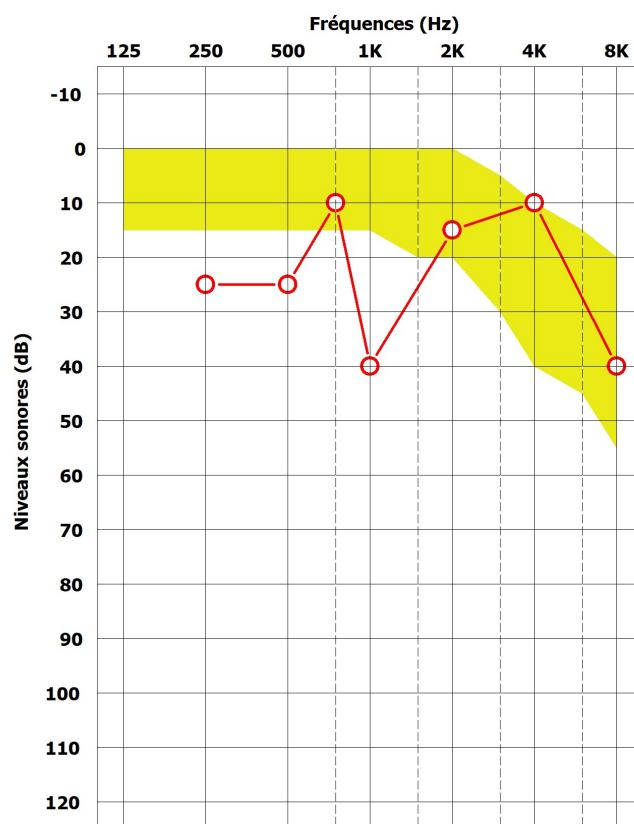

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	25	5		25		25		20
CA Droit		25	25	10	40		15		10		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes